

MEDVIE

Date du test: 09/05/2024 14:07:00

Durée: 4mn 53s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **MILLIMONO SAA SEKOU**

Date de naissance 01/01/2001

Age 23

Société COVEC/292


ID 24050914034511877

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

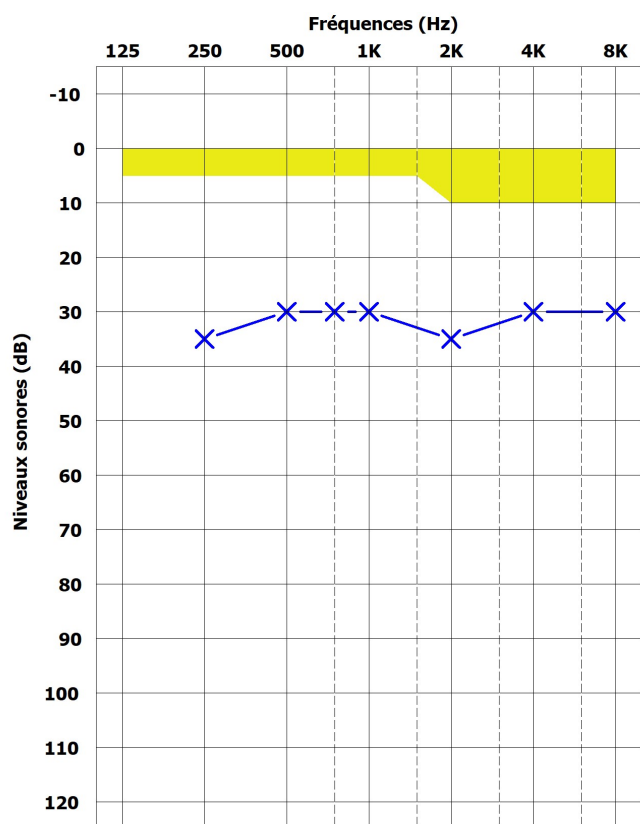

Oreille Gauche

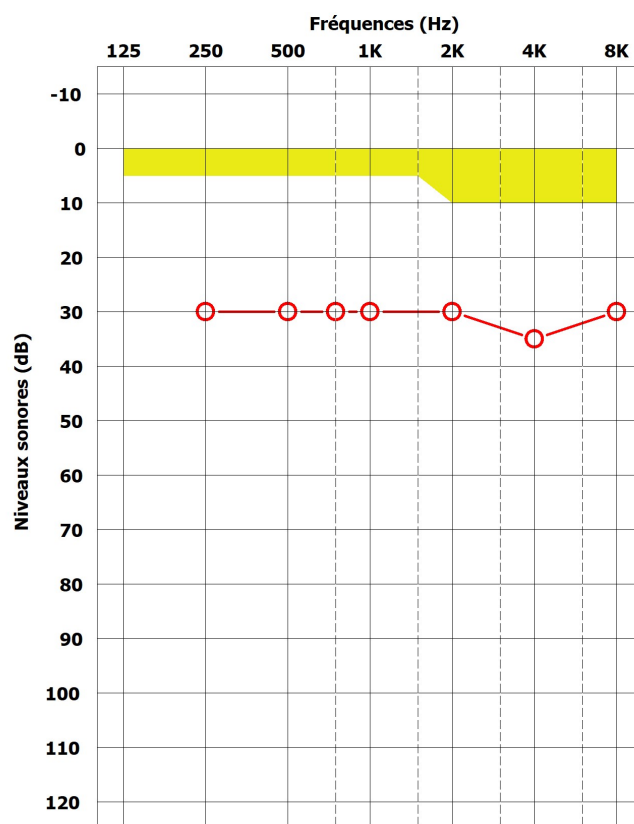

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	30	30	30		35		30		30
CA Droit		30	30	30	30		30		35		30

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	31,3 dB	---

Notes