

MEDVIE

Date du test: 23/05/2024 14:06:29

Durée: 5mn 12s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CONDE ISSA

Date de naissance 01/01/1994

Age 30

Société MV/COVEC


ID 24052314035300710

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

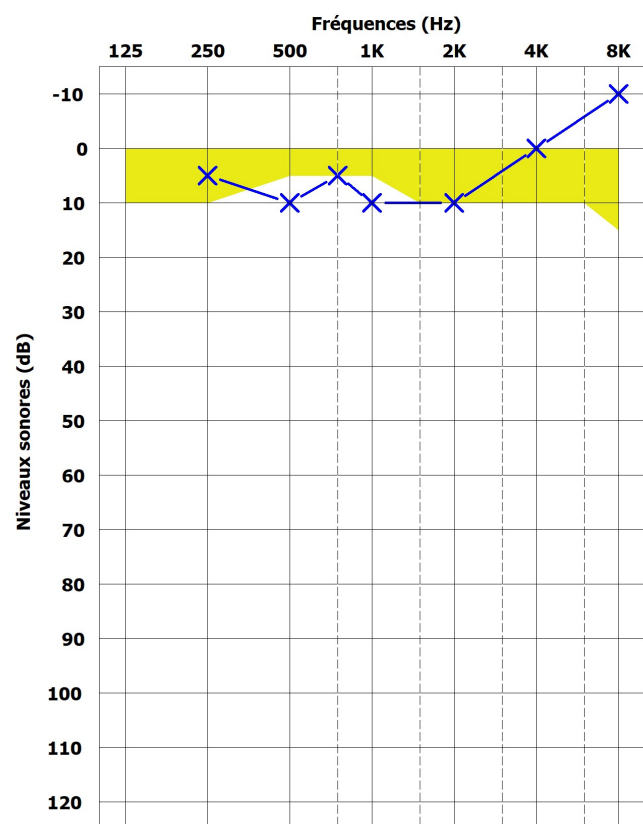

Oreille Gauche

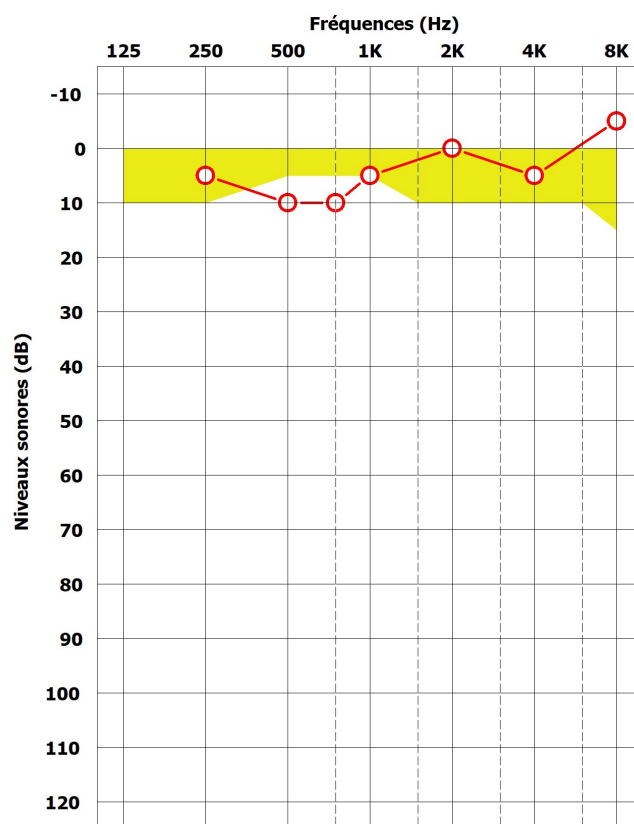

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	5	10		10		0		-10
CA Droit		5	10	10	5		0		5		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes