


MEDVIE

Date du test: 20/08/2024 13:28:55

Durée: 7mn 14s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

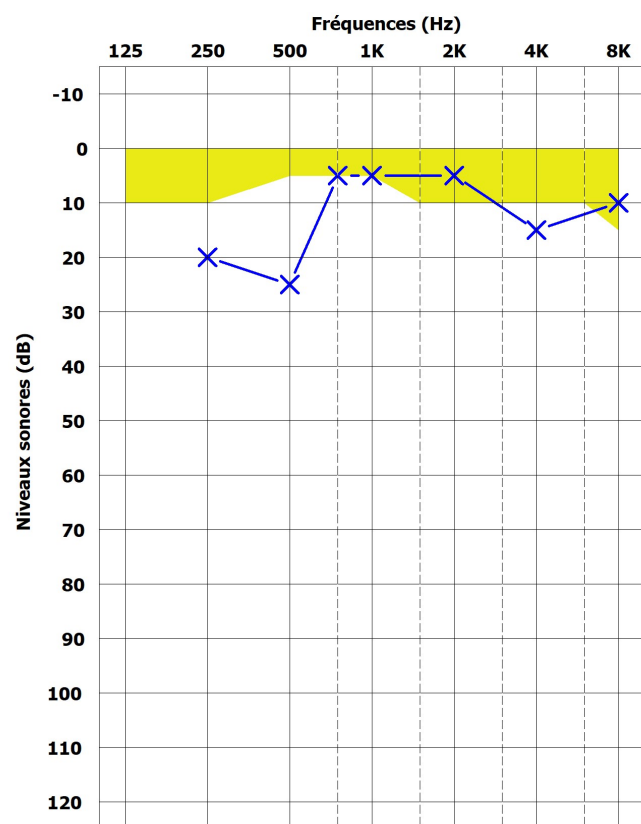

Oreille Gauche

Données Patient		KEITA SAYON
Date de naissance	18/03/1994	
Age	30	
Société	COVEC	
ID	24082013270139183	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

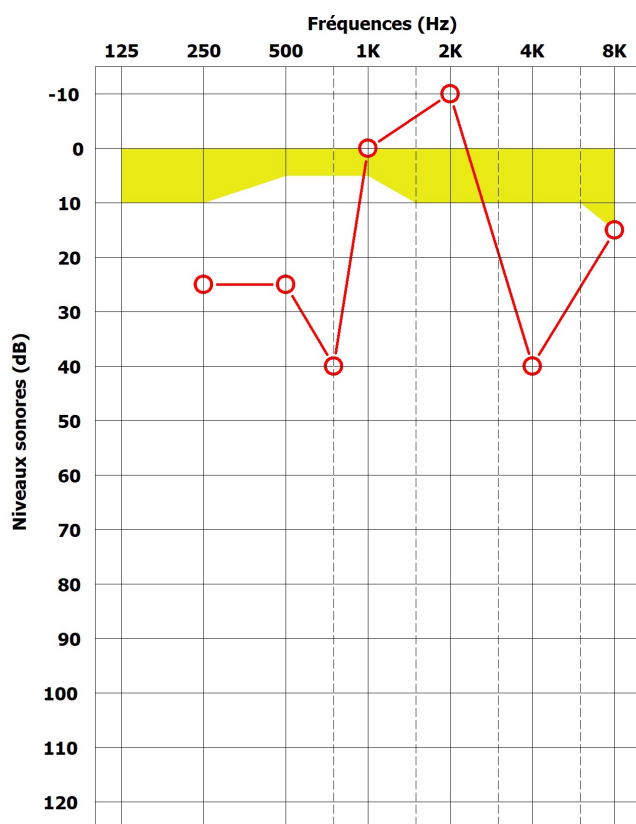

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	5	5		5		15		10
CA Droit		25	25	40	0		-10		40		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes