

MEDVIE


Date du test: 26/04/2024 10:23:48

Durée: 12mn 28s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   | TRAORE KALLOU |
|-------------------|-------------------|---------------|
| Date de naissance | 04/04/1997        |               |
| Age               | 27                |               |
| Société           | COVEC             |               |
| ID                | 24042610204394898 |               |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

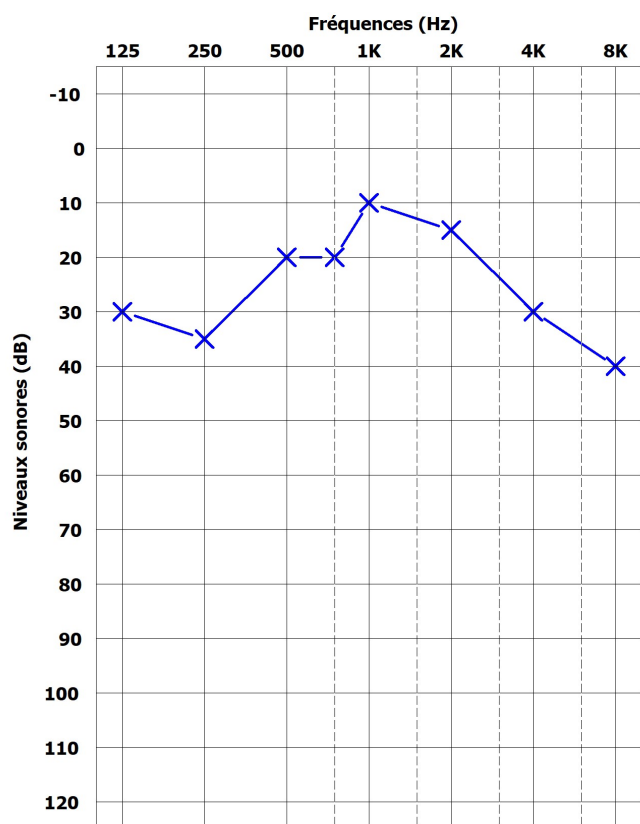

Oreille Gauche

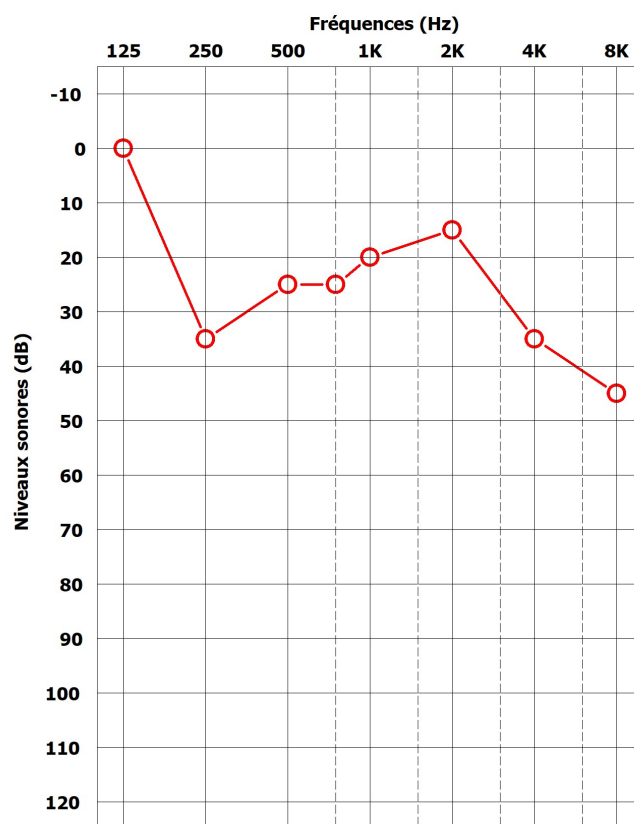

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 30  | 35  | 20  | 20  | 10 |     | 15 |    | 30 |    | 40 |
| CA Droit  | 0   | 35  | 25  | 25  | 20 |     | 15 |    | 35 |    | 45 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 18,8 dB | --- |
| CA Droit        | 23,8 dB | --- |

Notes