


MEDVIE


Date du test: 20/08/2024 13:42:00
Durée: 6mn 51s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TOUNKARA MOHAMED
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	COVEC
ID	24082013393379029

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

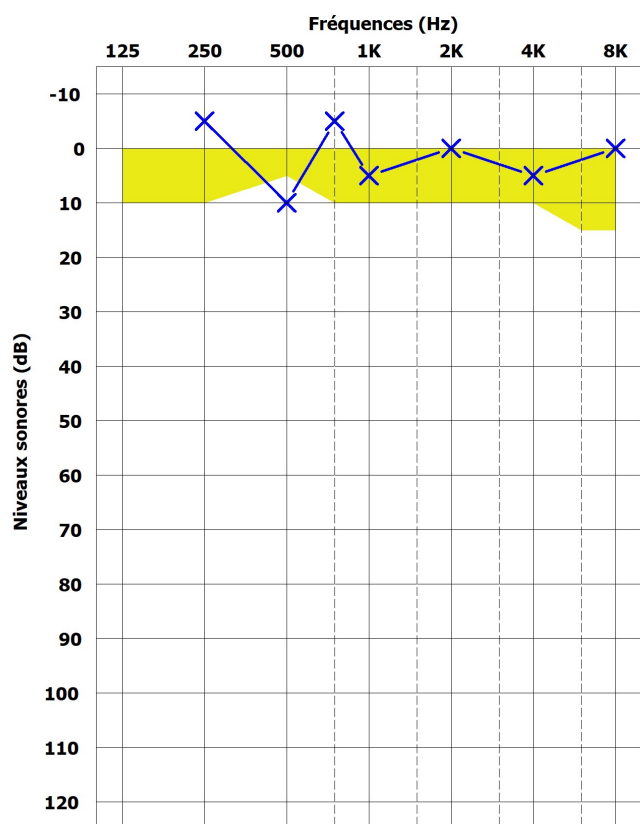

Oreille Gauche

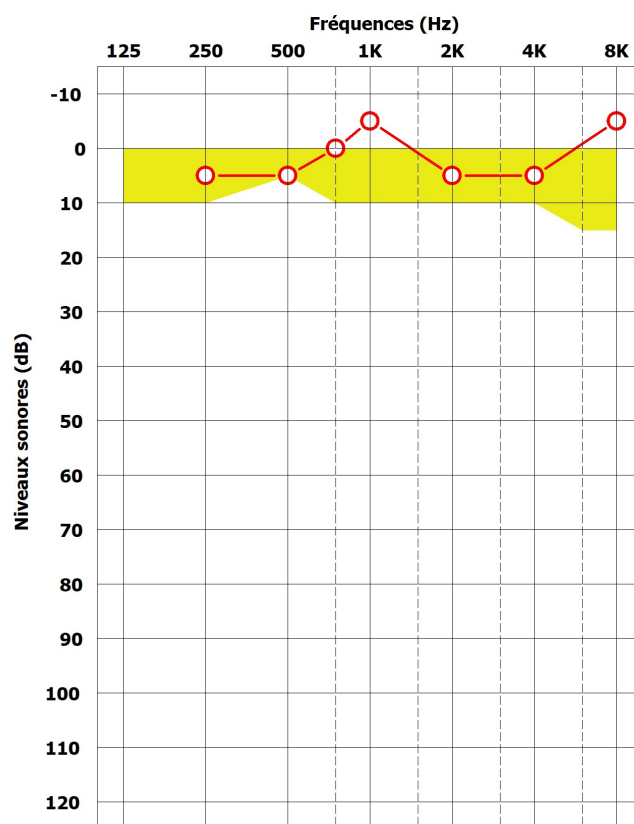

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	10	-5	5		0		5		0
CA Droit		5	5	0	-5		5		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes