

MED VIE


Date du test: 16/07/2024 10:57:56

Durée: 4mn 52s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
	FUFANA MAMADY SANTRA
Date de naissance	01/01/1967
Age	57
Société	COVEC
ID	24071610482084042

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

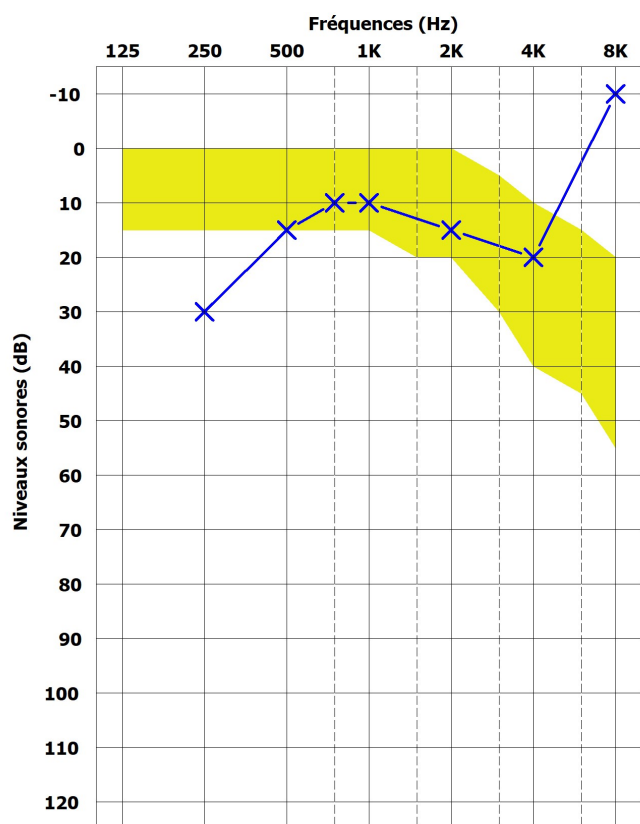

Oreille Gauche

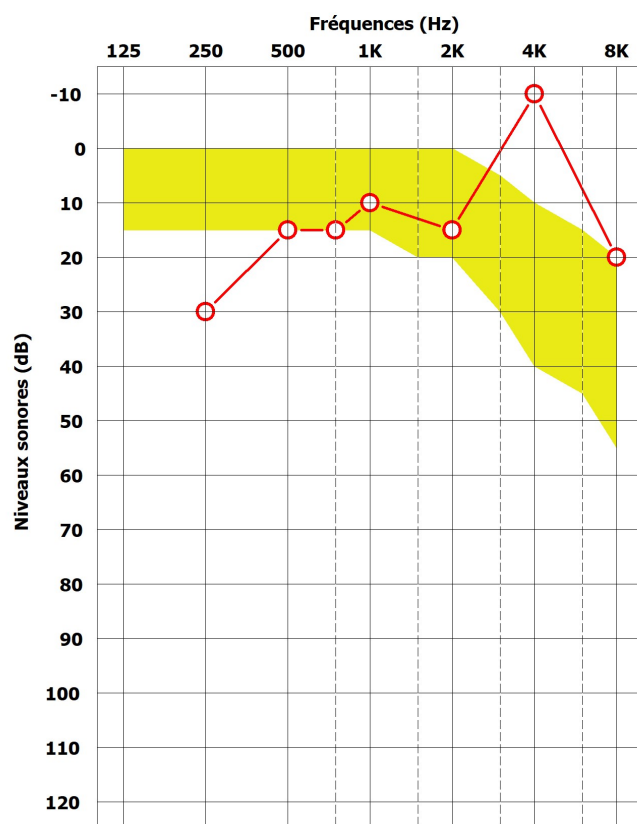

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	15	10	10		15		20		-10
CA Droit		30	15	15	10		15		-10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes