

MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 15:33:17

Durée: 6mn 16s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BERETE SORY	
Date de naissance	01/01/1980
Age	44
Société	COVEC
ID	24021915304309987

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

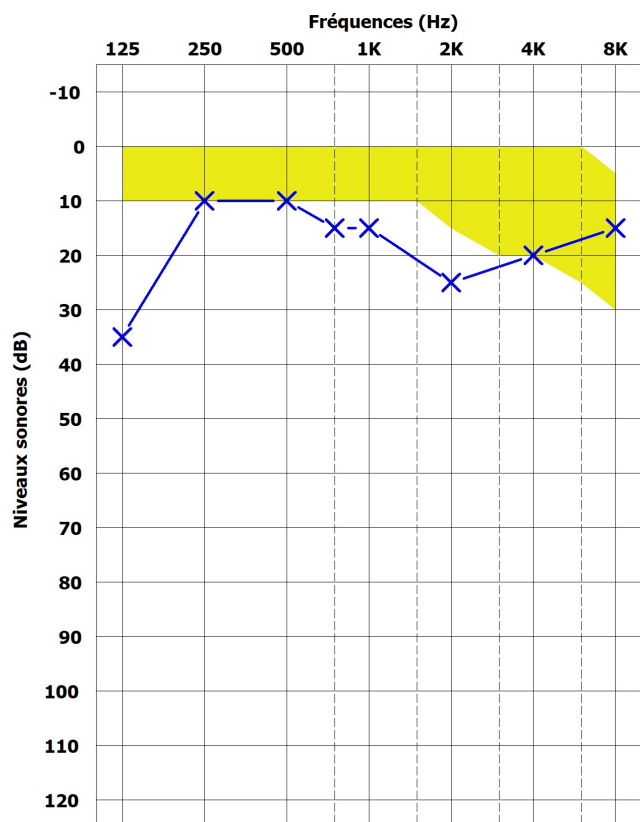

Oreille Gauche

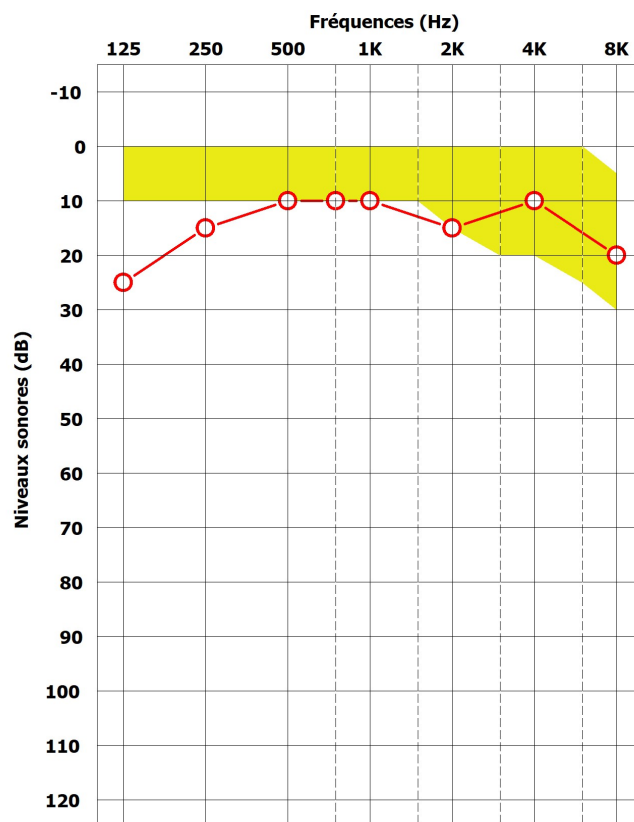

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	10	10	15	15		25		20		15
CA Droit	25	15	10	10	10		15		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes