

MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 15:22:38

Durée: 6mn 30s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CHERIF OUSMANE
Date de naissance	01/07/1996
Age	27
Société	COVEC
ID	24021915195872279

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

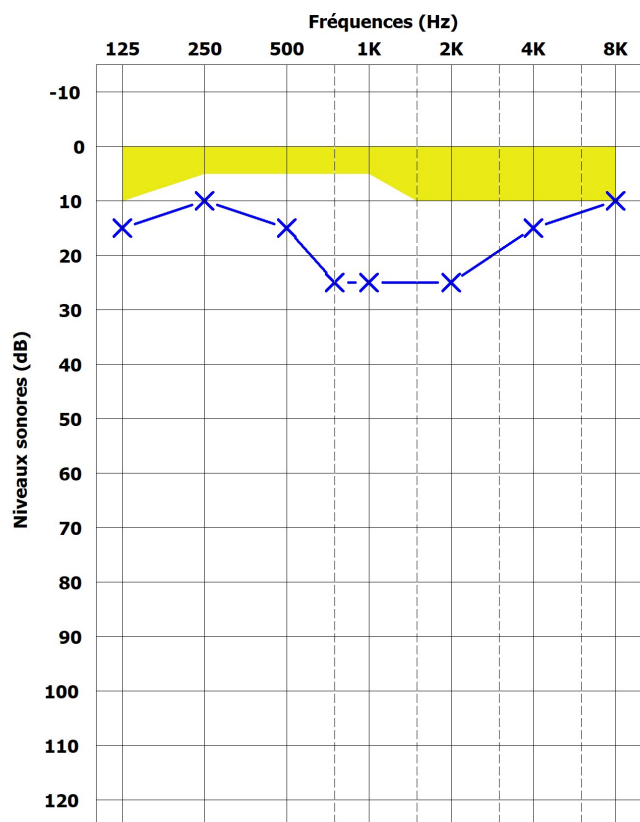

Oreille Gauche

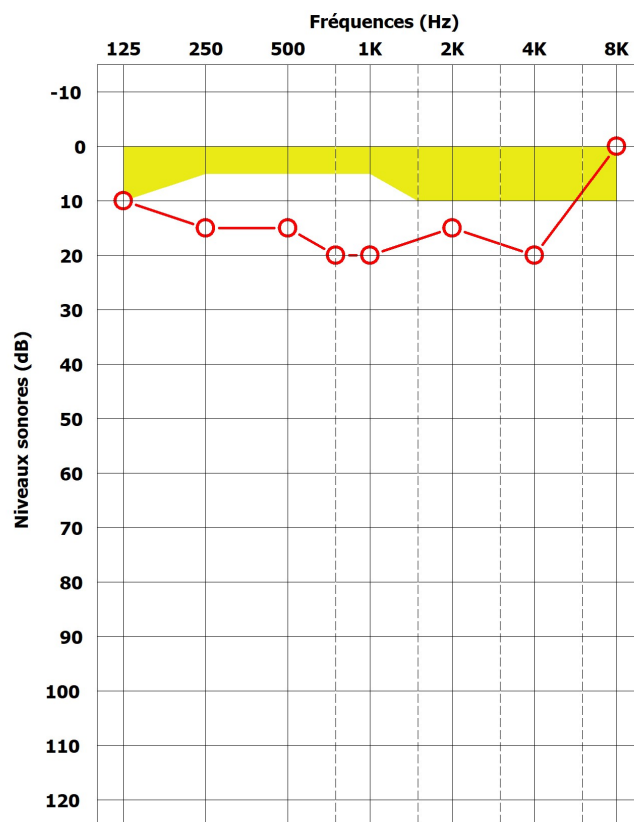

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	15	25	25		25		15		10
CA Droit	10	15	15	20	20		15		20		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes