

MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 10:37:34

Durée: 4mn 21s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SAGNO FOROMO
Date de naissance	01/01/1974	
Age	50	
Société	COVEC	
ID	24022210334393776	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

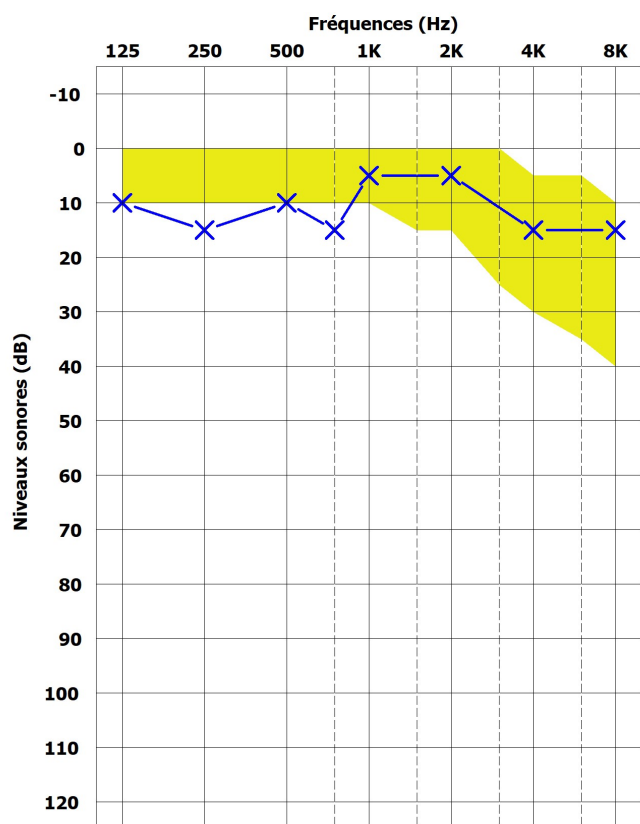

Oreille Gauche

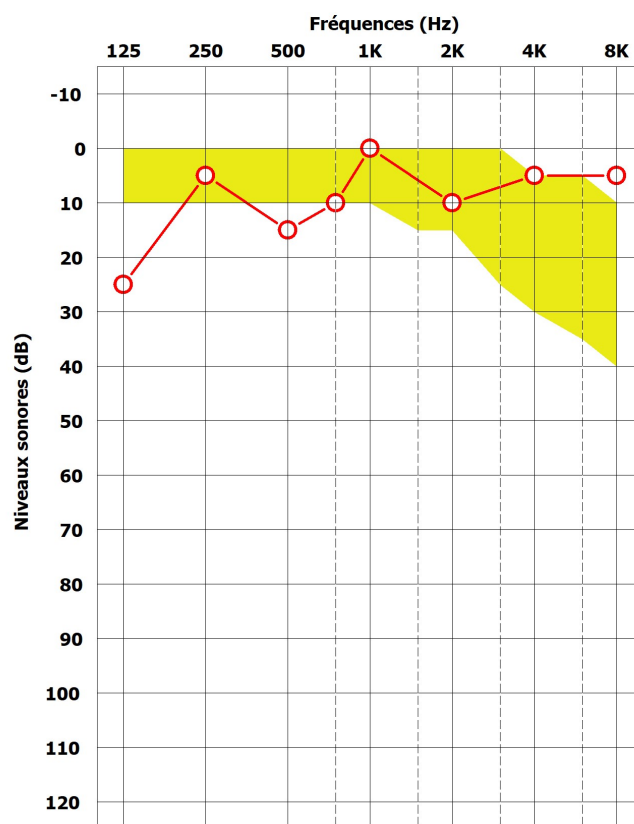

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	15	10	15	5		5		15		15
CA Droit	25	5	15	10	0		10		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes