


MEDVIE


Date du test: 20/08/2024 12:42:04
Durée: 5mn 05s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO MAMADOU ALIOU	
Date de naissance	08/10/1992
Age	31
Société	COVEC
ID	24082012392565189

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

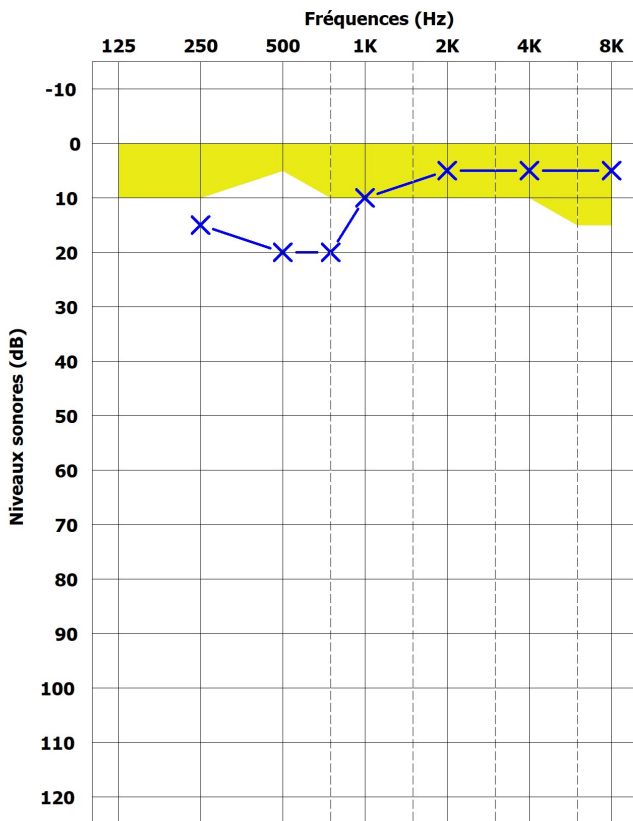

Oreille Gauche

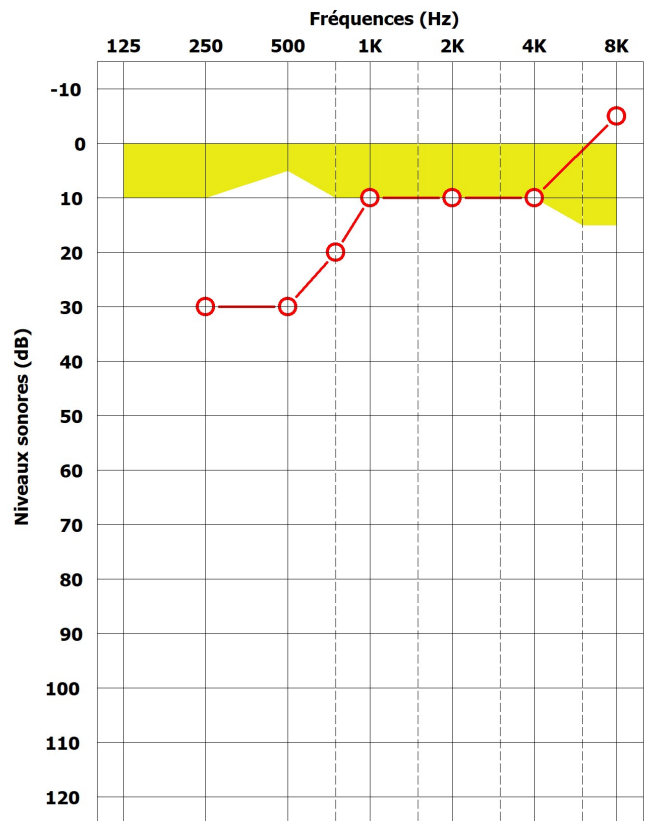

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	20	10		5		5		5
CA Droit		30	30	20	10		10		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes