


MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 13:30:54

Durée: 2mn 42s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

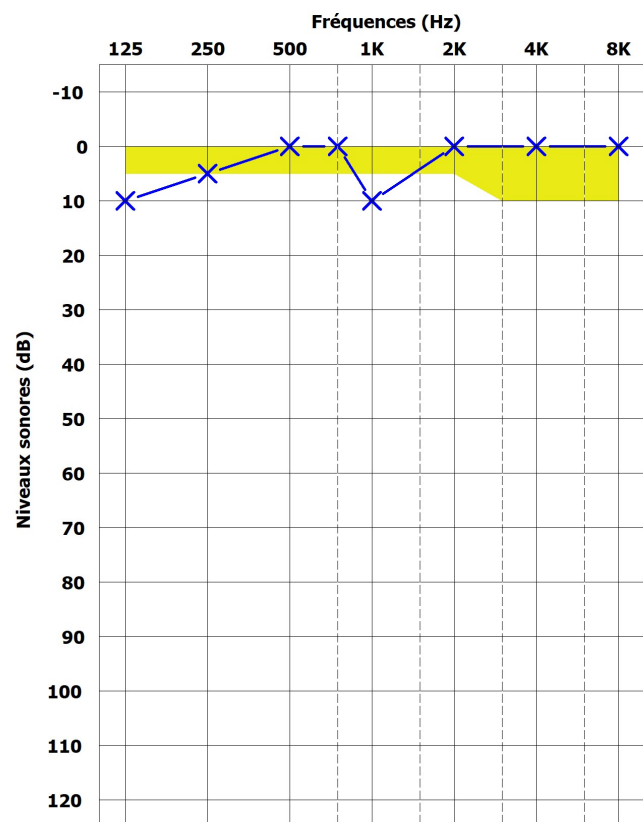

Oreille Gauche

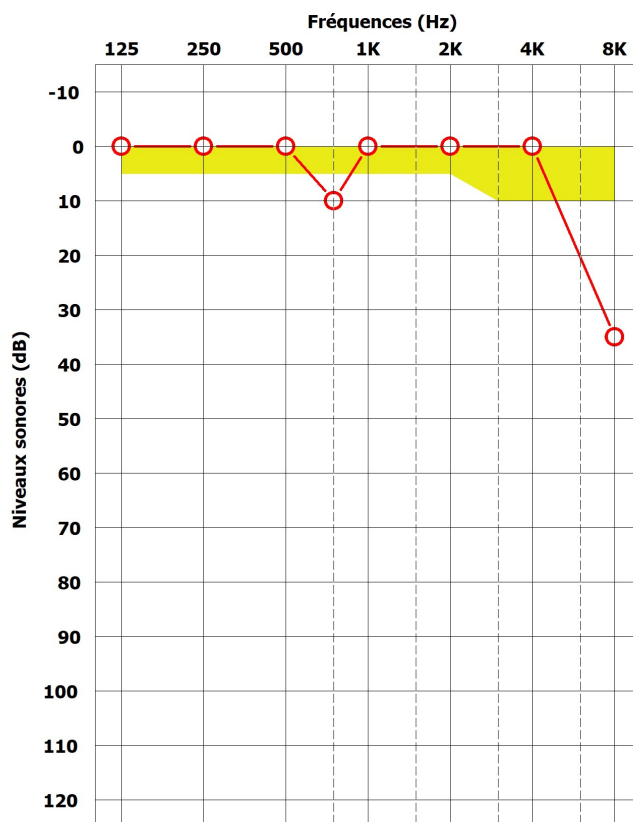

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	5	0	0	10		0		0		0
CA Droit	0	0	0	10	0		0		0		35

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes

Données Patient	KOUROUMA SOULEMANE
Date de naissance	01/07/2003
Age	20
Société	COVEC
ID	24022213265924897

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021