


MEDVIE


Date du test: 20/02/2024 10:22:55

Durée: 5mn 03s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

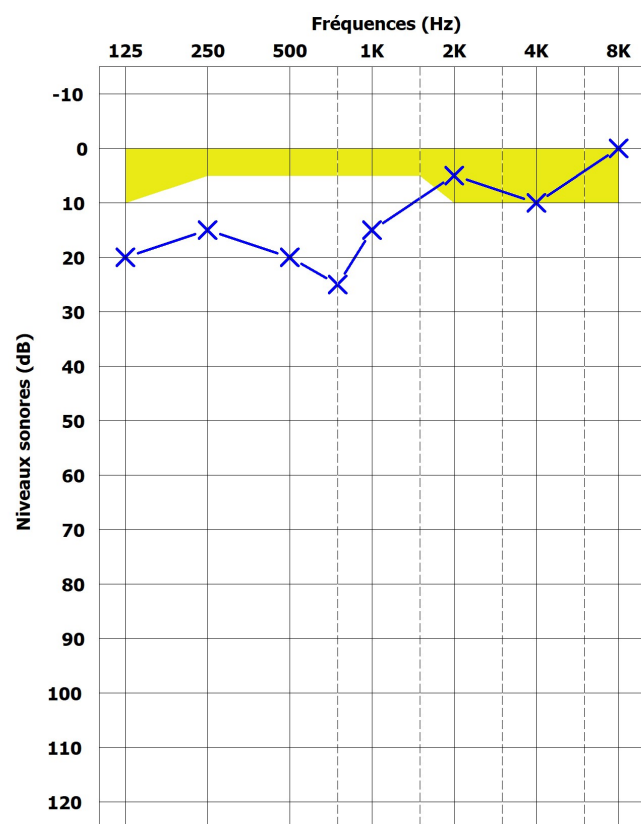

Oreille Gauche

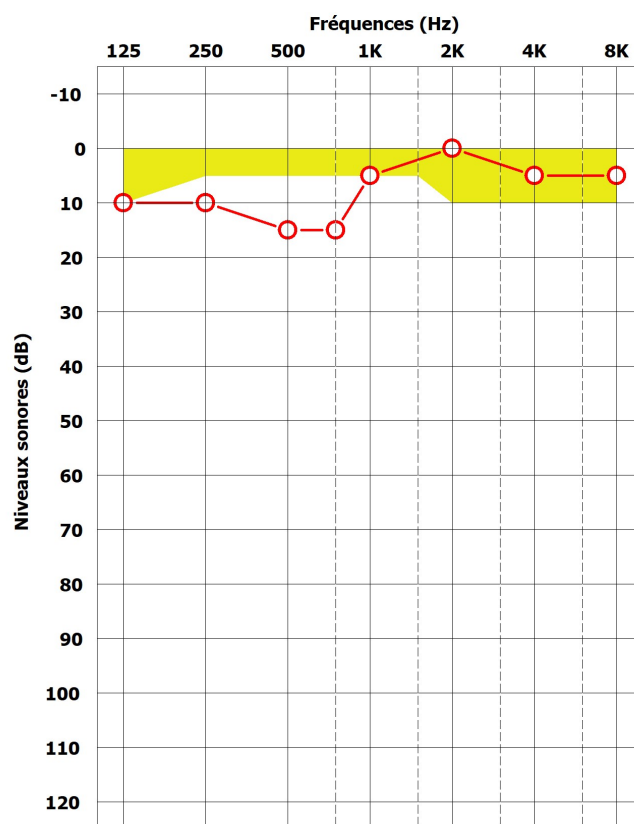

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	20	25	15		5		10		0
CA Droit	10	10	15	15	5		0		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO BANGALY
Date de naissance	18/01/1998
Age	26
Société	COVEC
ID	24022010194370817

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021