


MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 12:27:00

Durée: 4mn 05s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

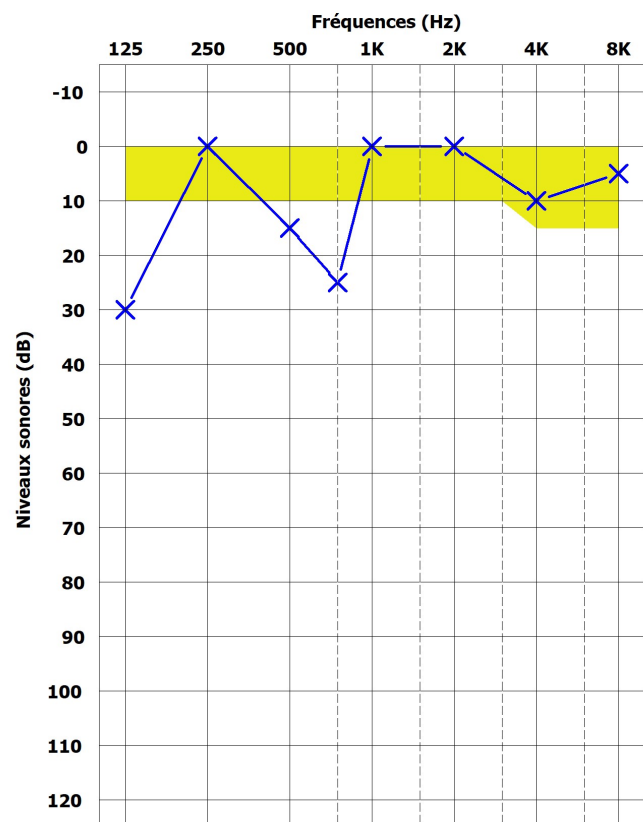

Oreille Gauche

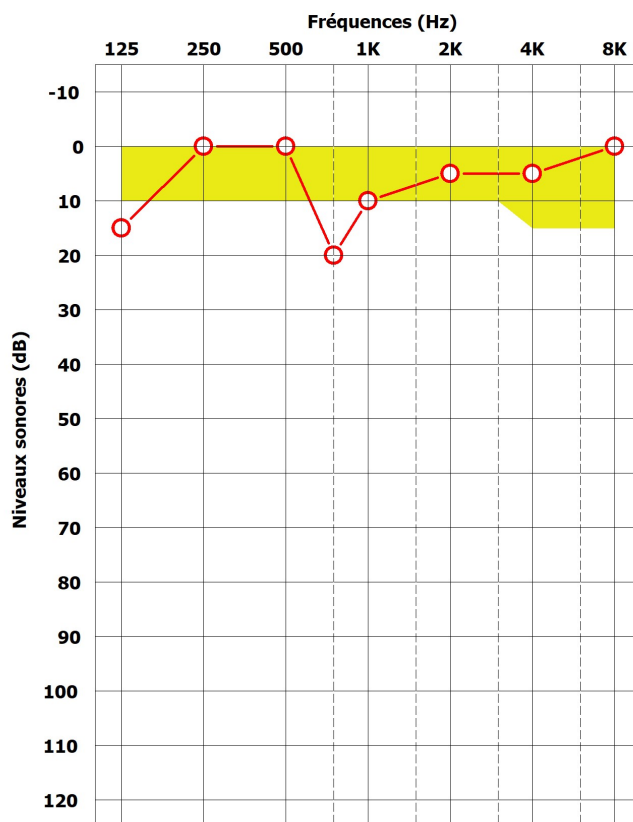

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	0	15	25	0		0		10		5
CA Droit	15	0	0	20	10		5		5		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient

BAYO GAOUSSOU

Date de naissance

01/01/1990

Age

34

Société

COVEC

ID

24031112242413249

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021