


Données Patient		TRAORE SEKOU
Date de naissance	01/01/1982	
Age	42	
Société	COVEC	
ID	24022013415099531	


MEDVIE

Date du test: 20/02/2024 13:46:01
 Durée: 6mn 08s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

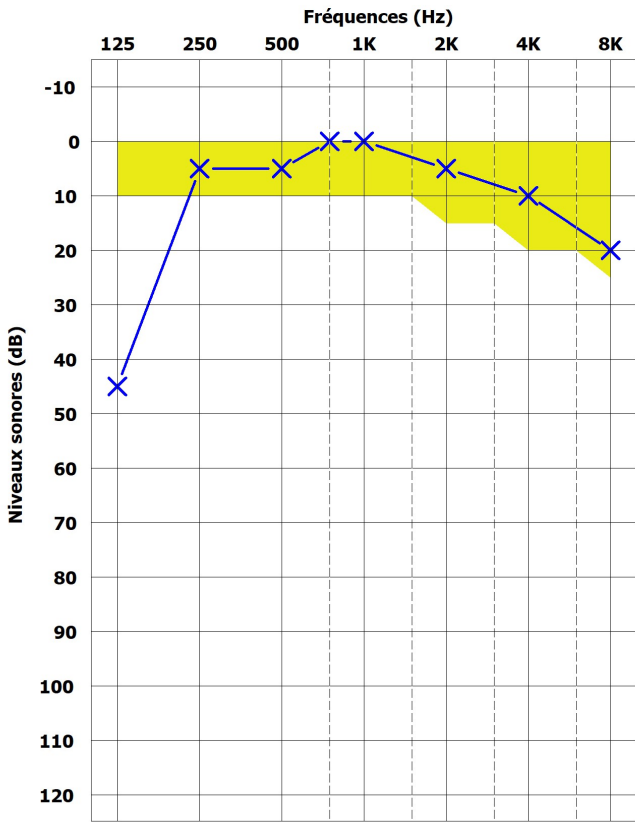

Oreille Gauche

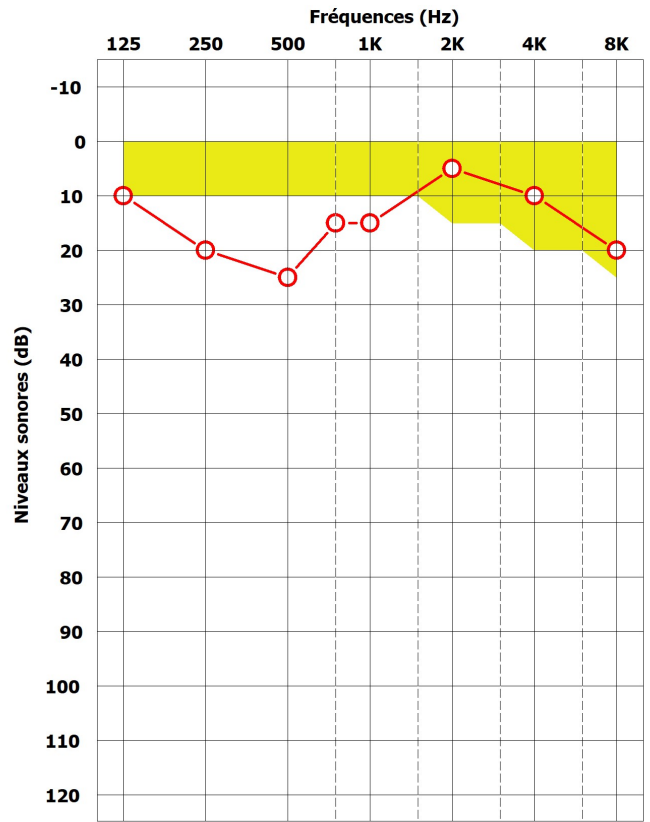

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	5	5	0	0		5		10		20
CA Droit	10	20	25	15	15		5		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	5,0 dB
CA Droit	13,8 dB	---

Notes