


MEDVIE


Date du test: 22/07/2024 12:36:49
Durée: 4mn 21s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KALLO SIDIKIBA	
Date de naissance	23/04/1991
Age	33
Société	COVEC
ID	24072212275065259

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

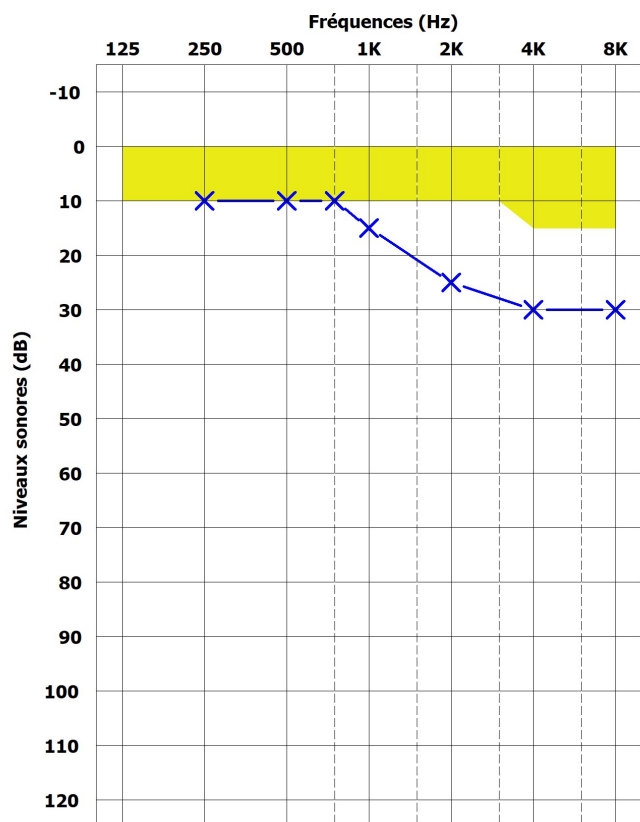

Oreille Gauche

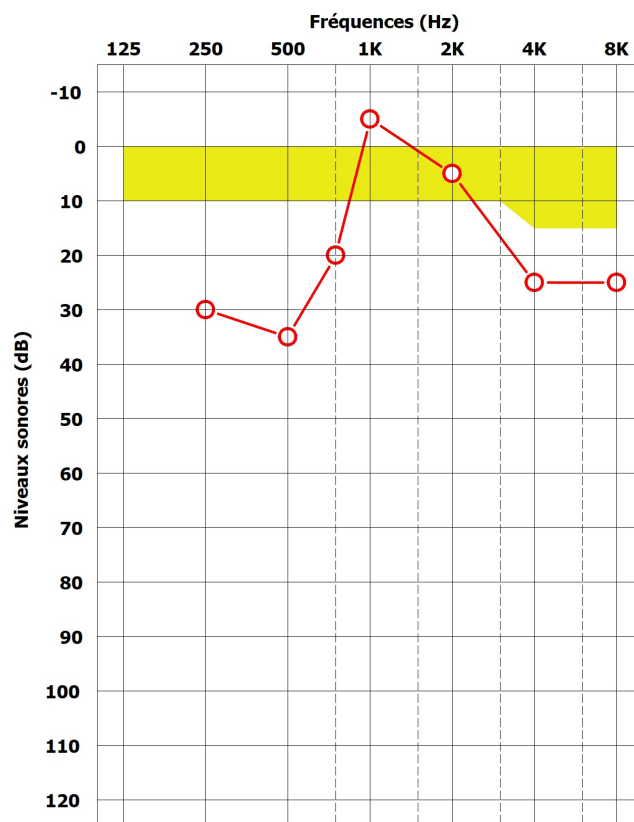

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	15		25		30		30
CA Droit		30	35	20	-5		5		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes