


MEDVIE

Date du test: 19/02/2024 10:01:50

Durée: 5mn 24s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

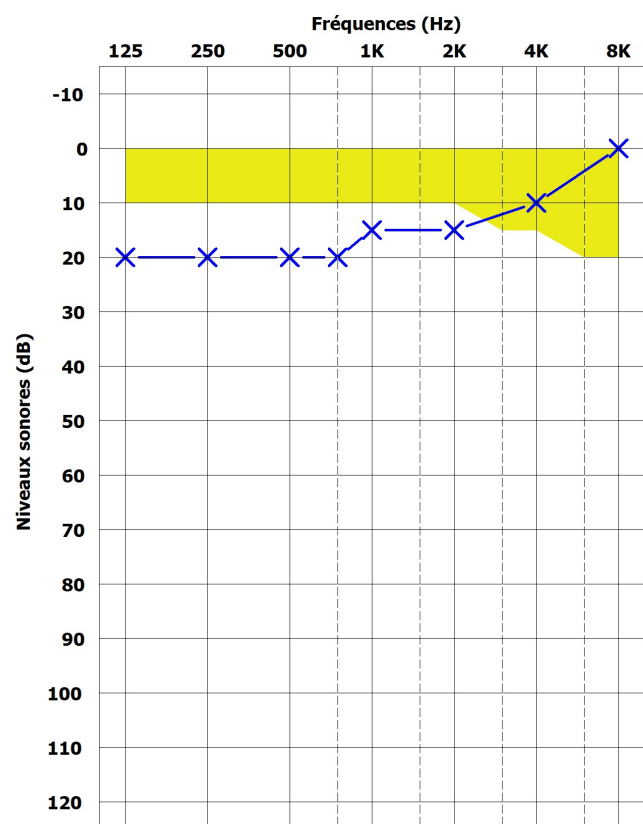

Oreille Gauche

Données Patient	
FOFANA YOUSOUF	
Date de naissance	01/07/1984
Age	39
Société	COVEC
ID	24021909401112037

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

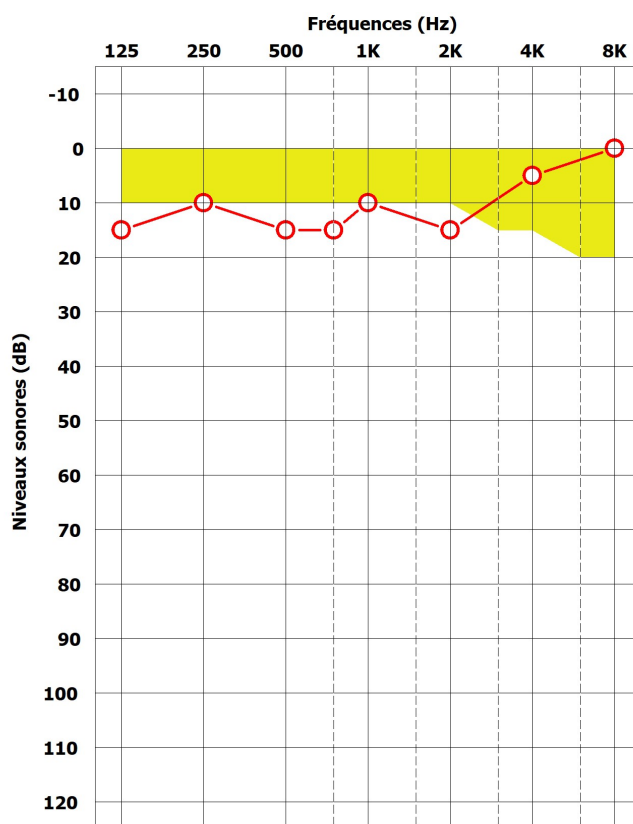

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	20	15		15		10		0
CA Droit	15	10	15	15	10		15		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes