

MEDVIE


Date du test: 20/02/2024 11:06:15

Durée: 8mn 25s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		KOMARA KEMO
Date de naissance	08/01/1977	
Age	47	
Société	COVEC	
ID	24022010523407318	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

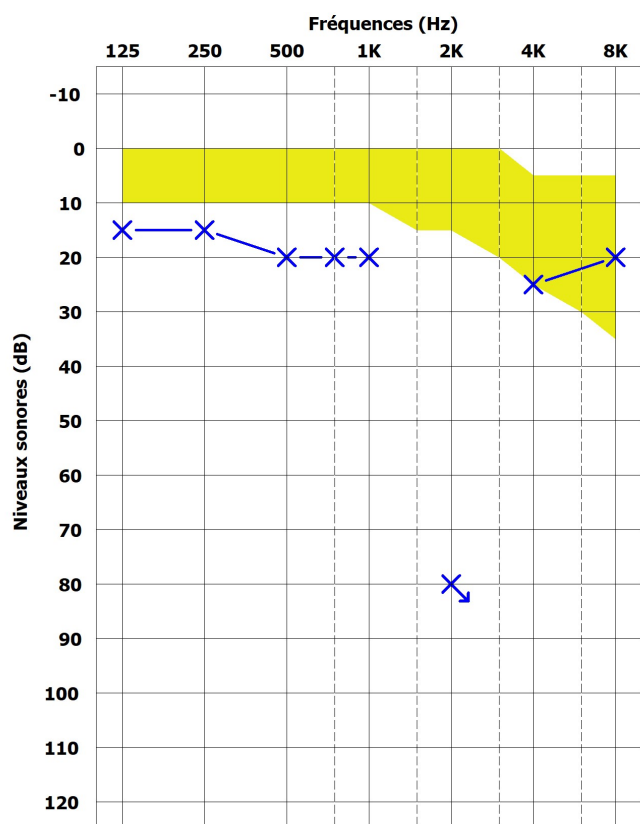

Oreille Gauche

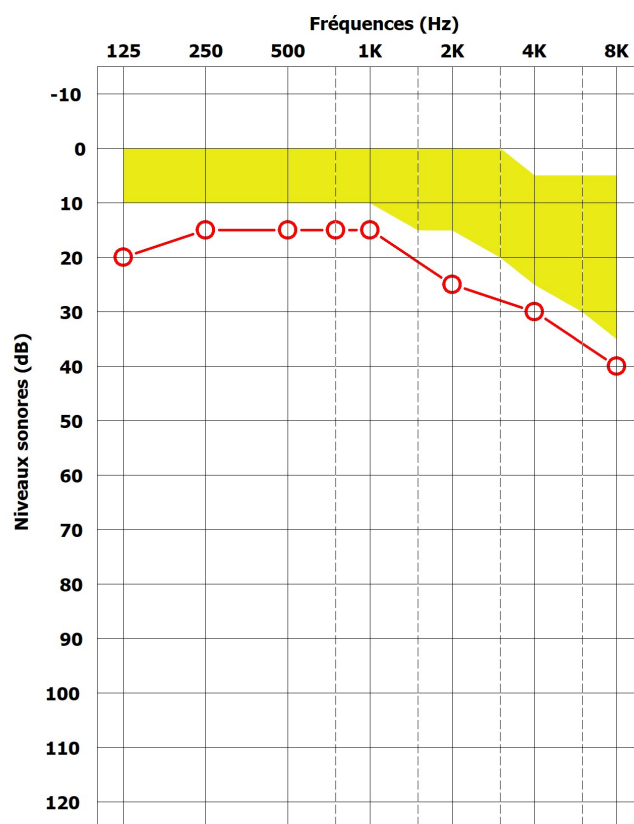

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	20	20	20		(80)		25		20
CA Droit	20	15	15	15	15		25		30		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes