

MEDVIE


Date du test: 22/05/2024 13:26:05

Durée: 4mn 57s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		ONIVOGUI DAORO
Date de naissance	03/04/1994	
Age	30	
Société	COVEC	
ID	24052213213816316	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

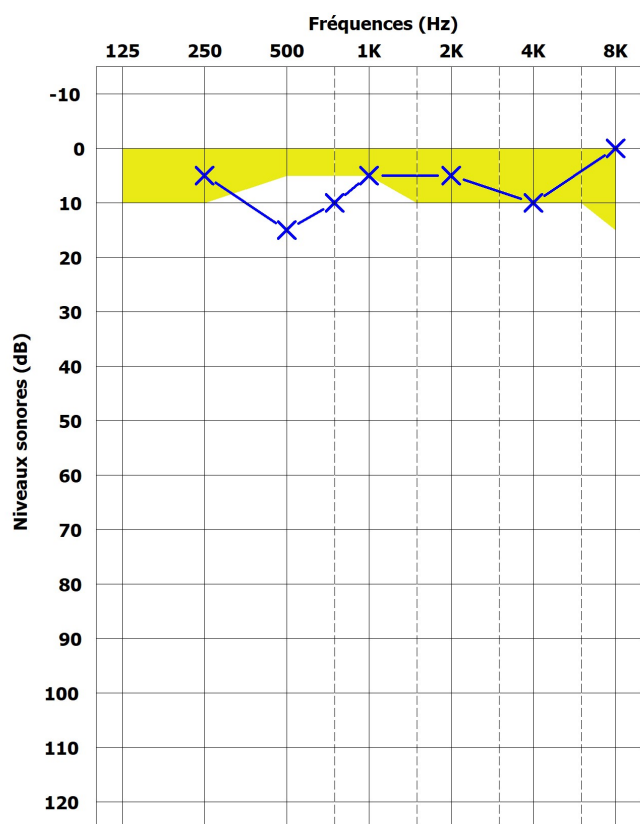

Oreille Gauche

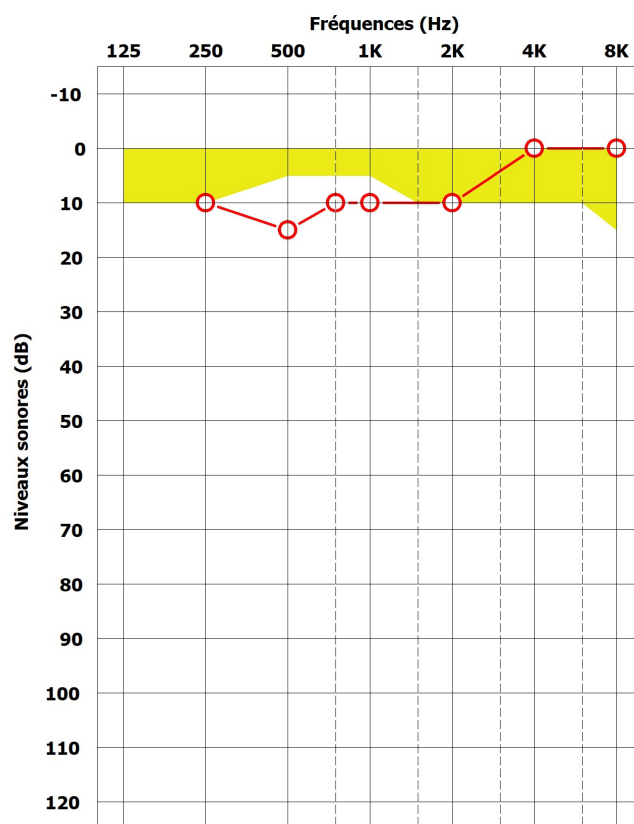

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	10	5		5		10		0
CA Droit		10	15	10	10		10		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes