

MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 10:21:07

Durée: 5mn 35s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA MAMADY	
Date de naissance	14/01/1977
Age	47
Société	COVEC
ID	24031110175892857

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

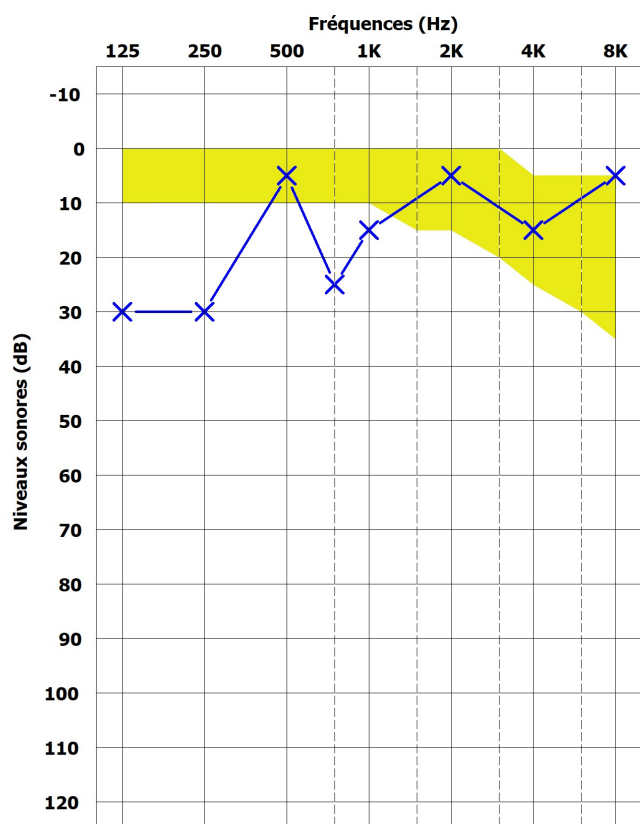

Oreille Gauche

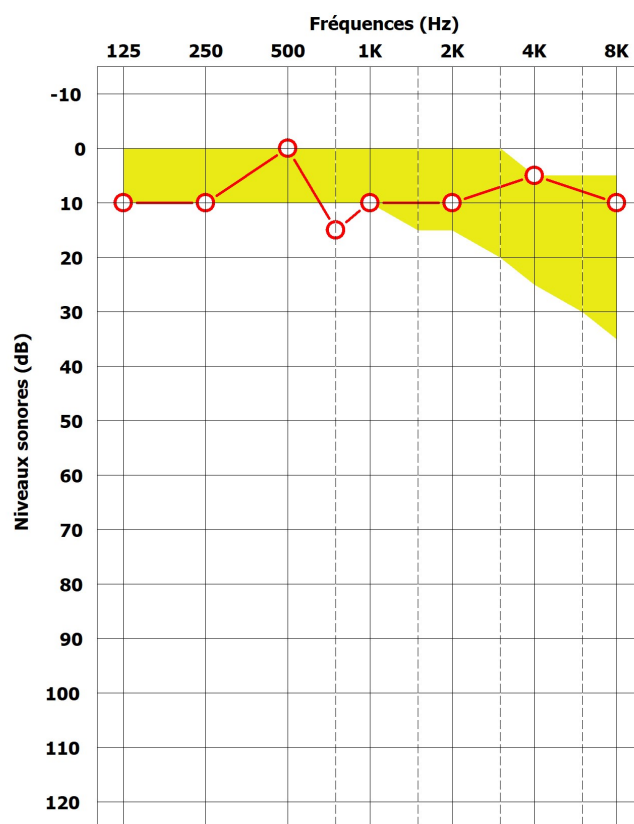

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	30	5	25	15		5		15		5
CA Droit	10	10	0	15	10		10		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes