

MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 12:40:25

Durée: 5mn 54s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA NABI ISSA	
Date de naissance	01/01/1992
Age	32
Société	COVEC
ID	24021912333355991

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

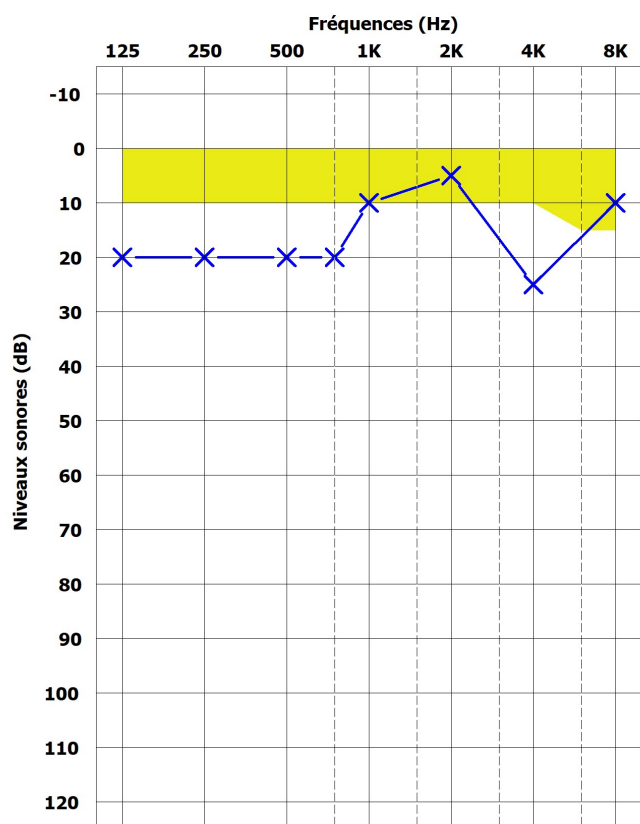

Oreille Gauche

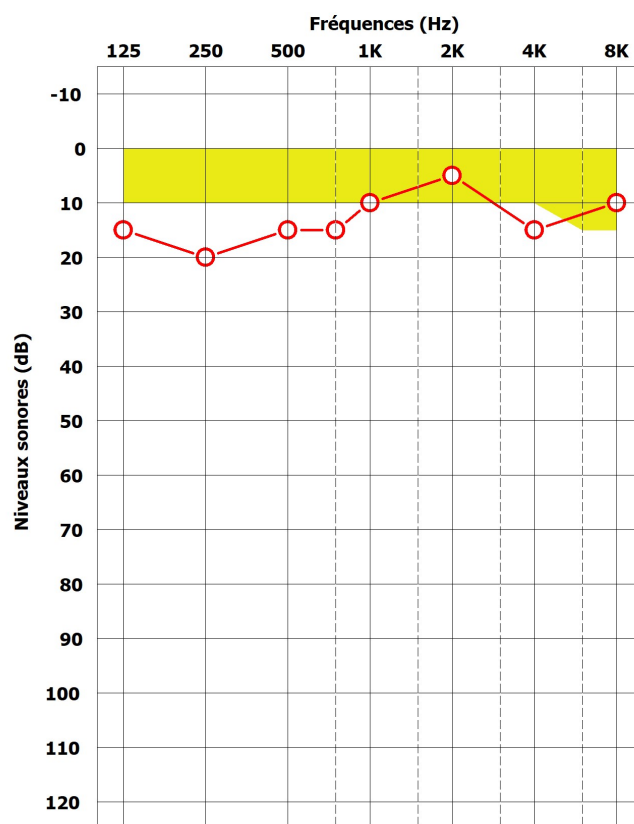

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	20	10		5		25		10
CA Droit	15	20	15	15	10		5		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes