


MEDVIE


Date du test: 20/02/2024 15:03:01

Durée: 6mn 14s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

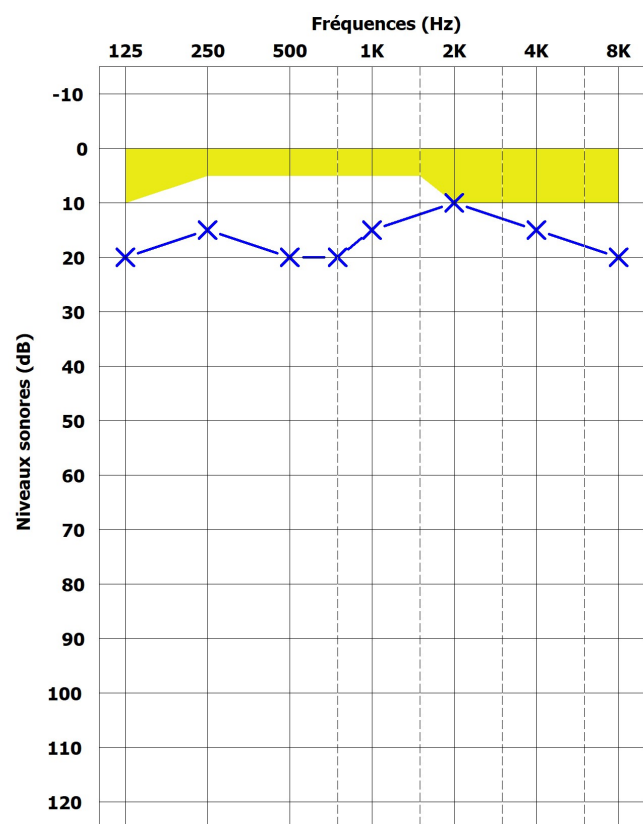

Oreille Gauche

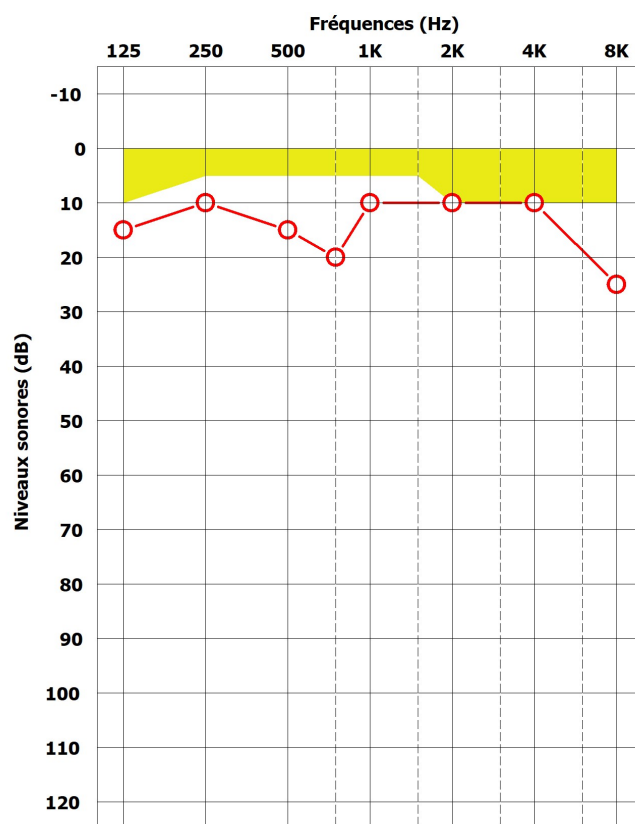

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	20	20	15		10		15		20
CA Droit	15	10	15	20	10		10		10		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient

CAMARA AMADOU

Date de naissance

05/06/1997

Age

26

Société

COVEC

ID

24022015004064253

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021