

MEDVIE


Date du test: 19/02/2025 11:42:54

Durée: 4mn 21s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
GAO HONGHIN	
Date de naissance	21/02/1975
Age	49
Société	COVEC
ID	25021911412388468

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

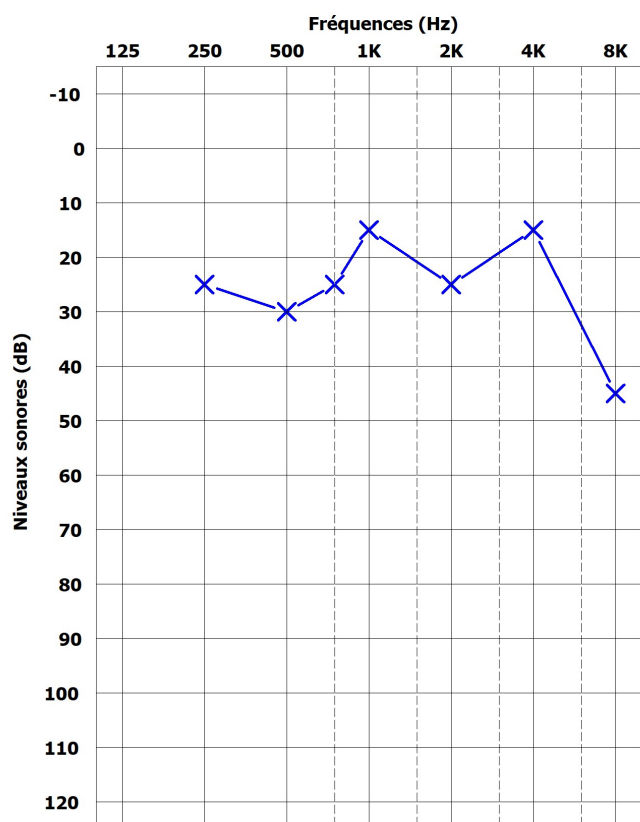

Oreille Gauche

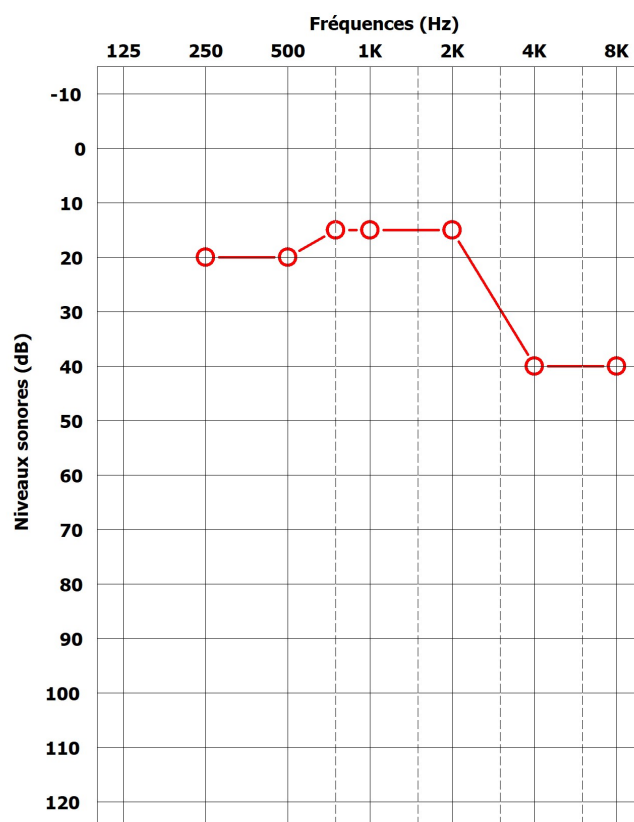

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	15		25		15		45
CA Droit		20	20	15	15		15		40		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes