

MEDVIE

Date du test: 19/02/2024 10:51:44

Durée: 3mn 06s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

KONATE SIAKA

Date de naissance 01/01/1987

Age 37

Société COVEC


ID 24021910465769404

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

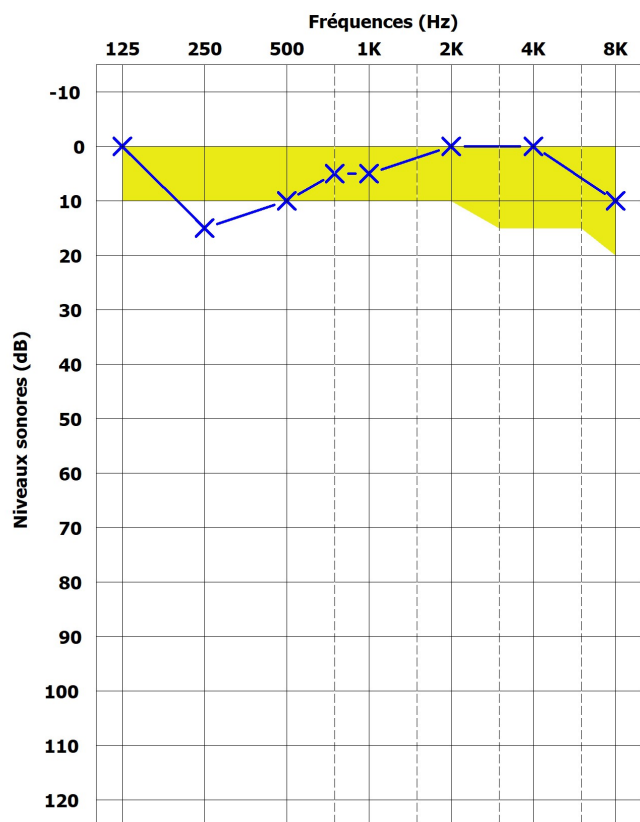

Oreille Gauche

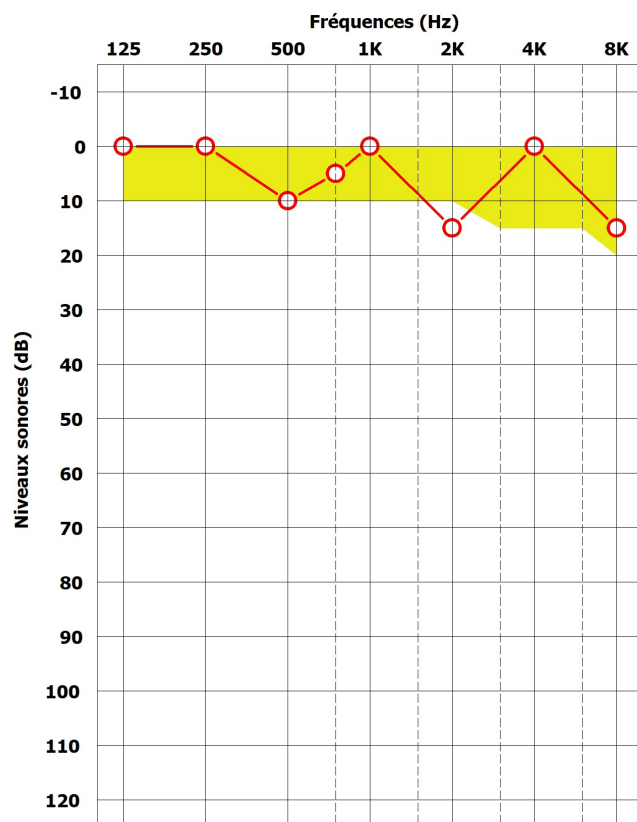

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	0	15	10	5	5		0		0		10
CA Droit	0	0	10	5	0		15		0		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes