

MEDVIE


Date du test: 13/03/2024 09:18:39

Durée: 7mn 02s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| KEÏTA N'GOUACE    |                   |
| Date de naissance | 04/05/1991        |
| Age               | 32                |
| Société           | COVEC             |
| ID                | 24031309154154994 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

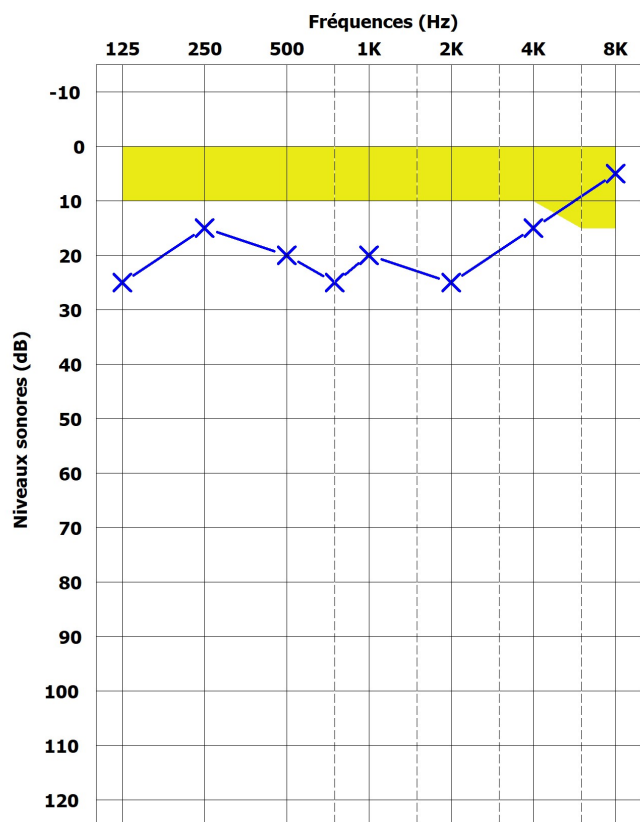

Oreille Gauche

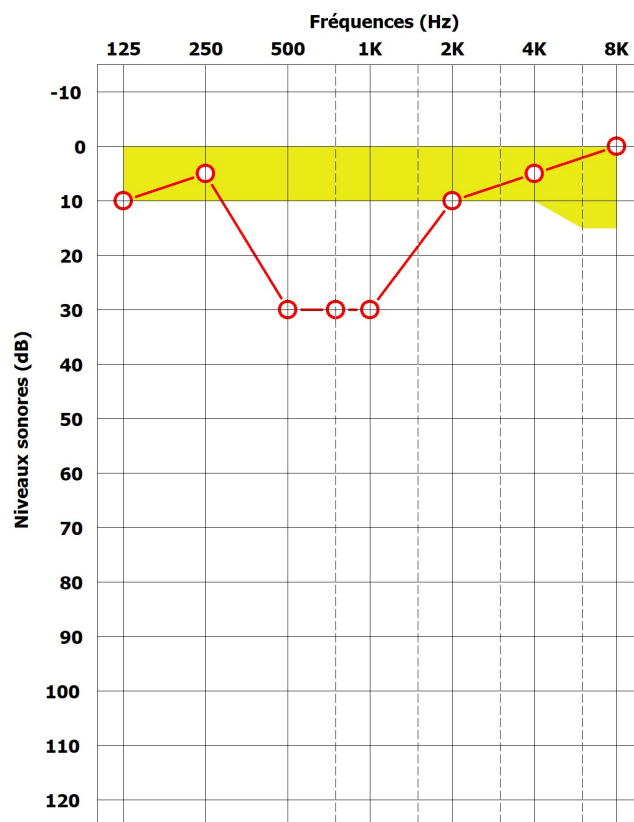

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 25  | 15  | 20  | 25  | 20 |     | 25 |    | 15 |    | 5  |
| CA Droit  | 10  | 5   | 30  | 30  | 30 |     | 10 |    | 5  |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 20,0 dB | --- |
| CA Droit        | 18,8 dB | --- |

Notes