

MEDVIE


Date du test: 20/02/2024 14:19:29

Durée: 6mn 48s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUMBOUYA DAOUDA	
Date de naissance	20/05/1982
Age	41
Société	COVEC
ID	24022014105601207

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

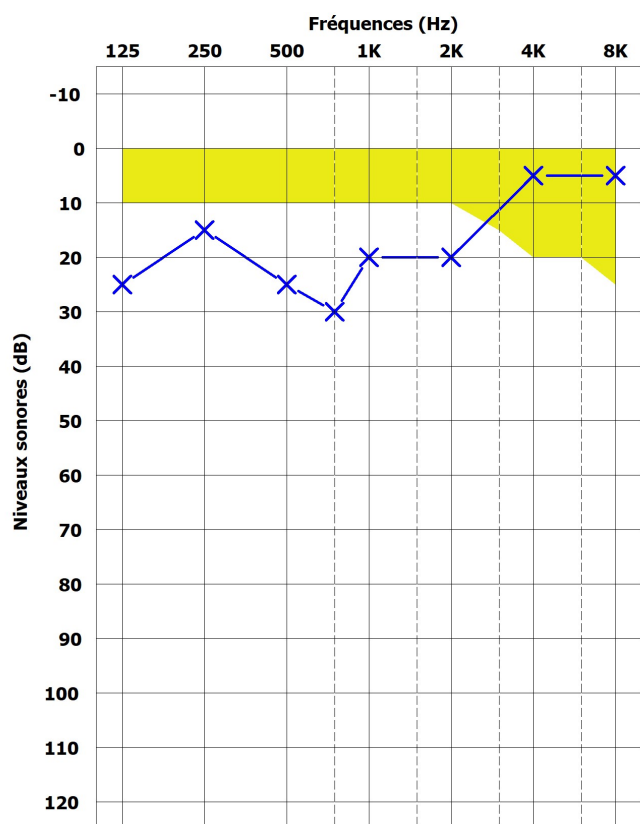

Oreille Gauche

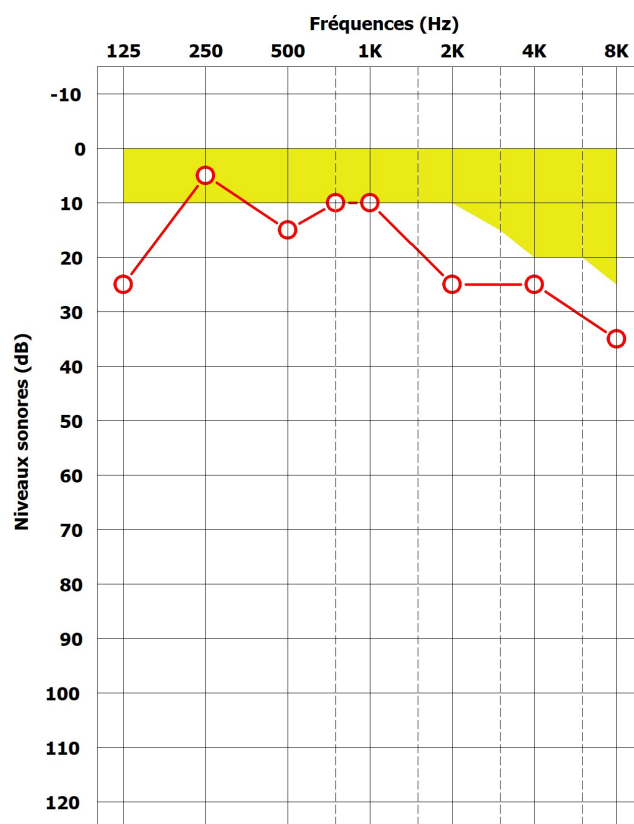

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	25	30	20		20		5		5
CA Droit	25	5	15	10	10		25		25		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes