


MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 18:06:29
Durée: 8mn 29s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF MOHAMED	
Date de naissance	01/08/1981
Age	42
Société	COVEC
ID	24022418031993478

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

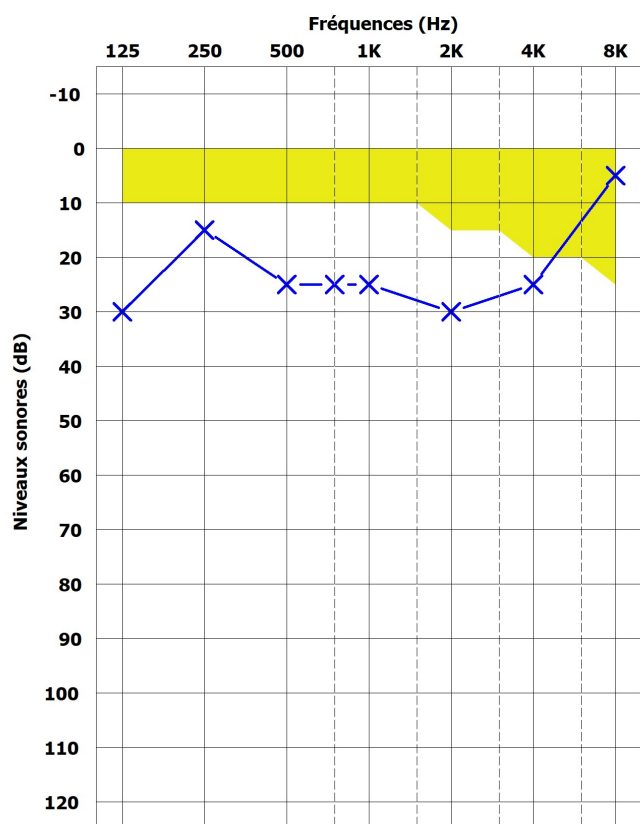

Oreille Gauche

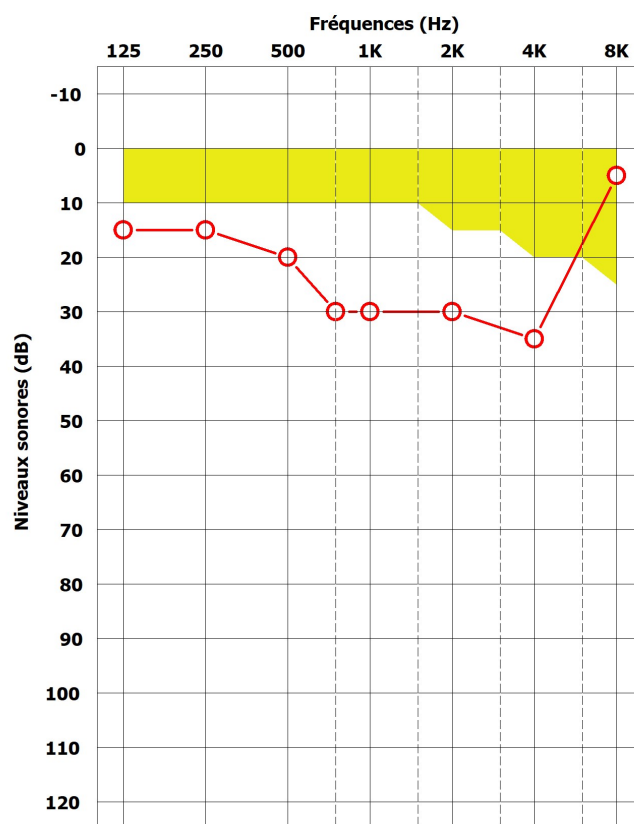

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	15	25	25	25		30		25		5
CA Droit	15	15	20	30	30		30		35		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes