


MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 14:10:23
Durée: 5mn 41s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOLOMOU NOEL	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	COVEC
ID	24022214073293090

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

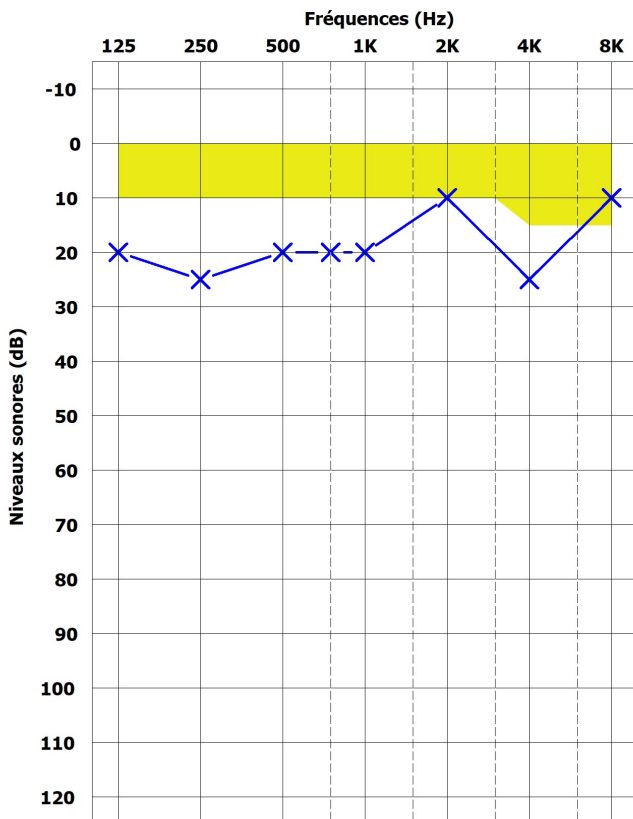

Oreille Gauche

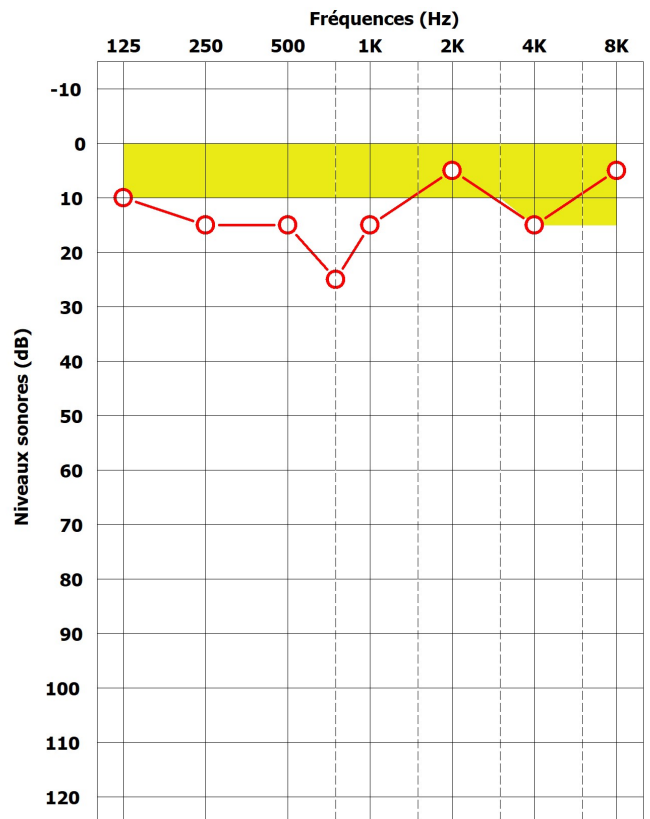

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	25	20	20	20		10		25		10
CA Droit	10	15	15	25	15		5		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes