



| Données Patient   |                   | BERETE Aboubacar |
|-------------------|-------------------|------------------|
| Date de naissance | 10/11/2000        |                  |
| Age               | 23                |                  |
| Société           | mv/covec/49       |                  |
| ID                | 24022011264137450 |                  |

Date du test: 20/02/2024 11:28:59  
Durée: 4mn 44s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

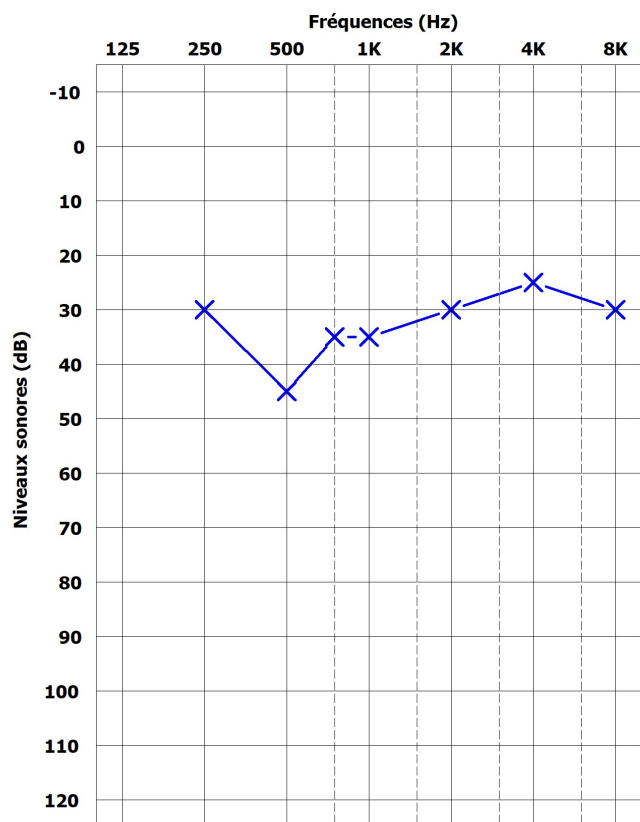

Oreille Gauche

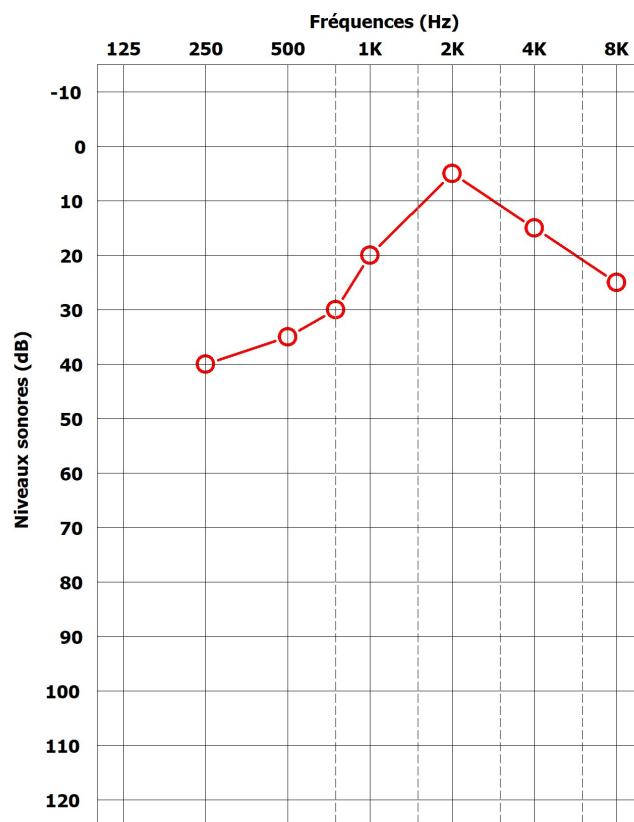

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 30  | 45  | 35  | 35 |     | 30 |    | 25 |    | 30 |
| CA Droit  |     | 40  | 35  | 30  | 20 |     | 5  |    | 15 |    | 25 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 33,8 dB | --- |
| CA Droit        | 18,8 dB | --- |

Notes