

MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 15:47:40

Durée: 4mn 42s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>CONDE MAMADY</b> |                   |
| Date de naissance   | 18/07/1996        |
| Age                 | 27                |
| Société             | BCOVEC/282        |
| ID                  | 24050615441508055 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

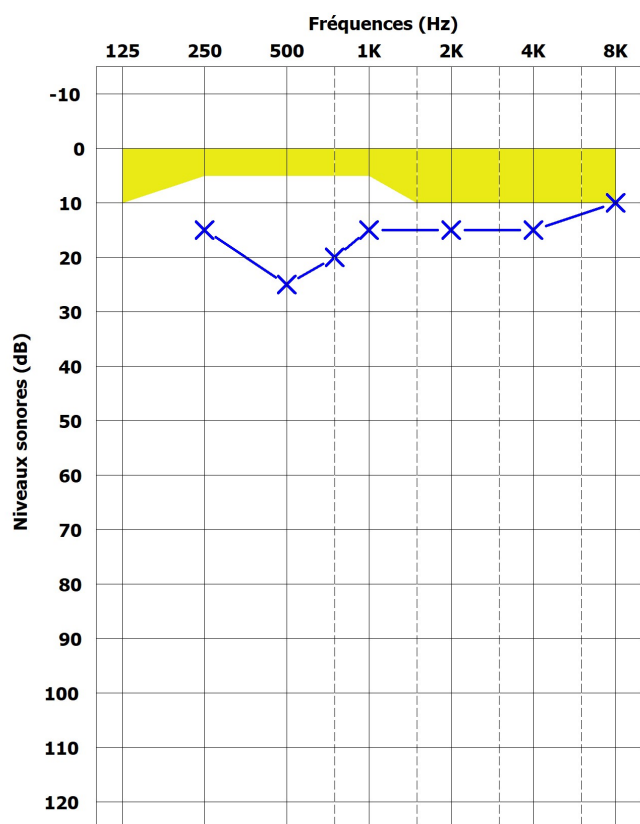

Oreille Gauche

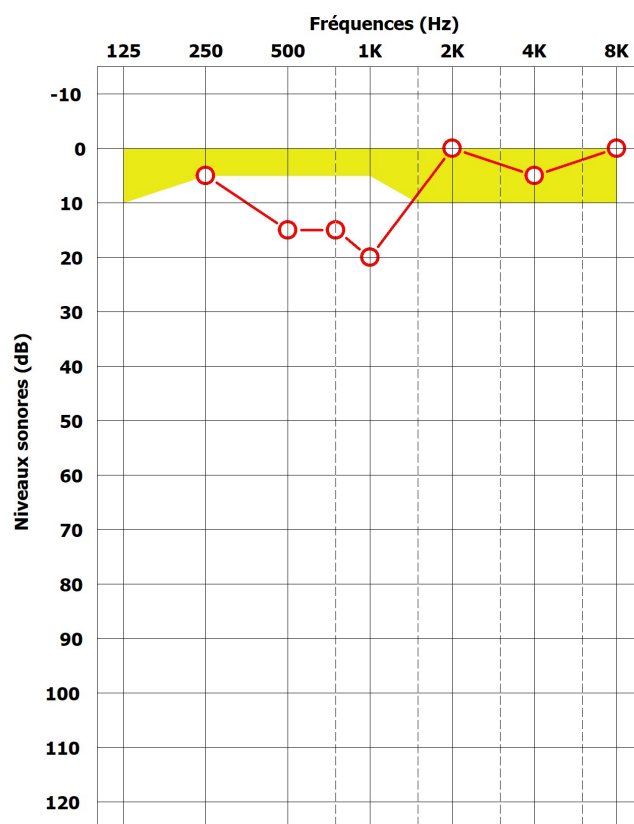

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 25  | 20  | 15 |     | 15 |    | 15 |    | 10 |
| CA Droit  |     | 5   | 15  | 15  | 20 |     | 0  |    | 5  |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 17,5 dB | --- |
| CA Droit        | 10,0 dB | --- |

Notes