


MEDVIE


Date du test: 13/03/2024 09:53:51
Durée: 6mn 54s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA GASSIMOU	
Date de naissance	01/01/1980
Age	44
Société	COVEC
ID	24031309514180121

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

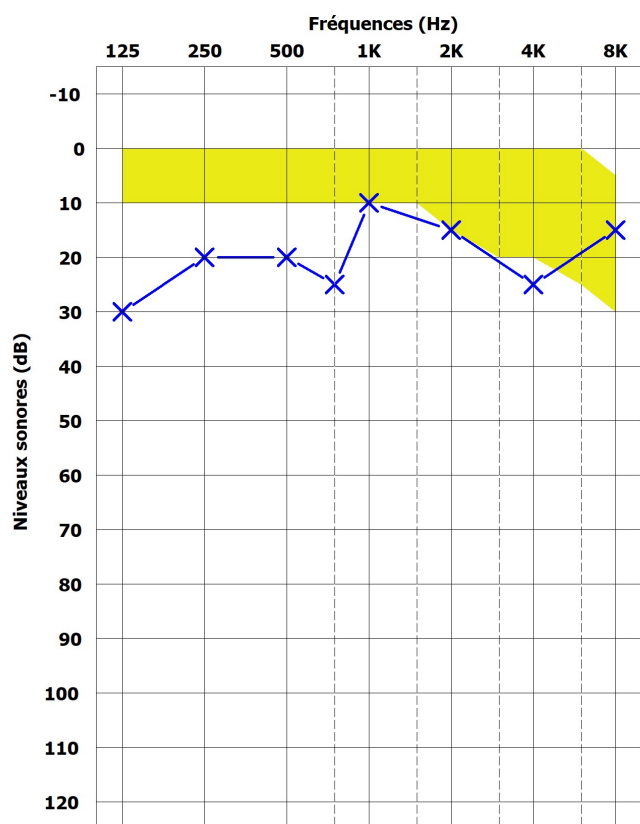

Oreille Gauche

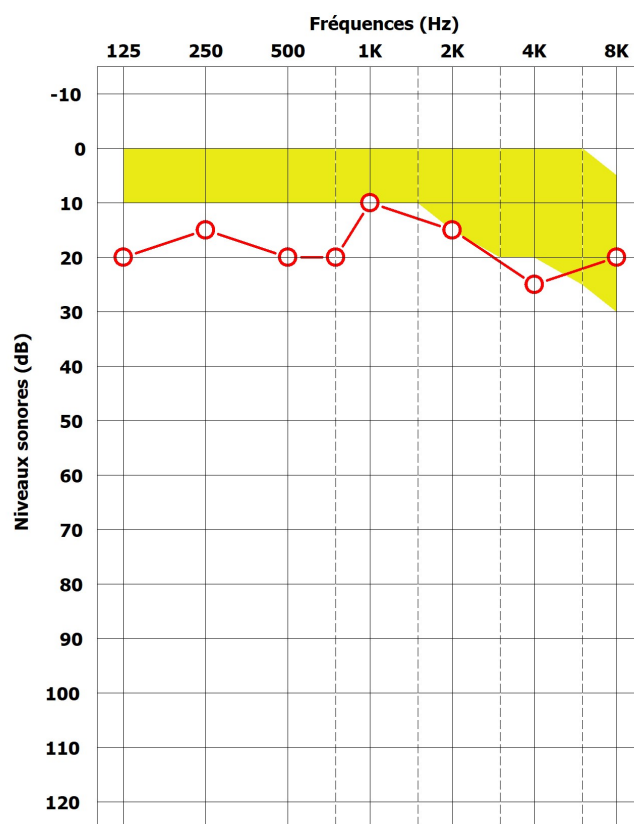

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	20	20	25	10		15		25		15
CA Droit	20	15	20	20	10		15		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes