

MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 10:50:32

Durée: 7mn 39s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA BLESE
Date de naissance	10/10/1975	
Age	48	
Société	COVEC	
ID	24022210473665047	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

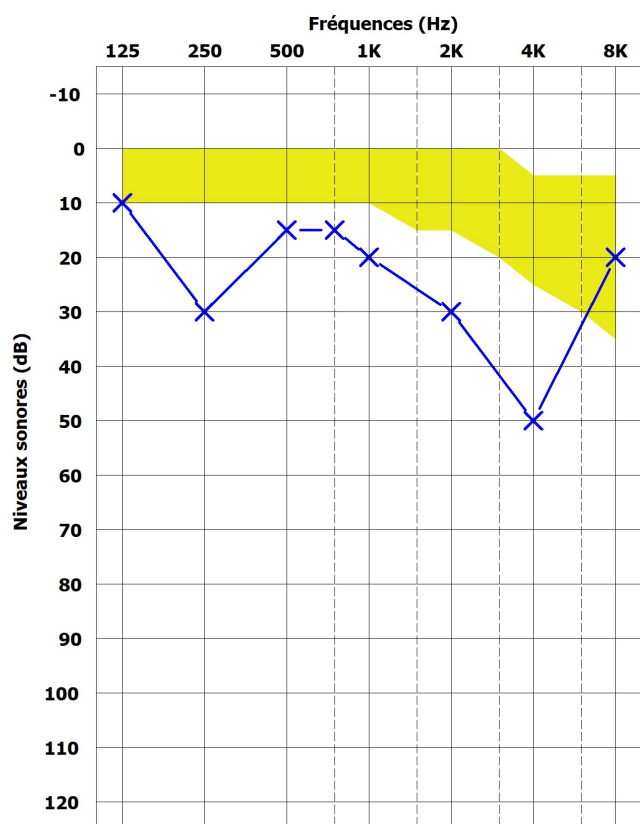

Oreille Gauche

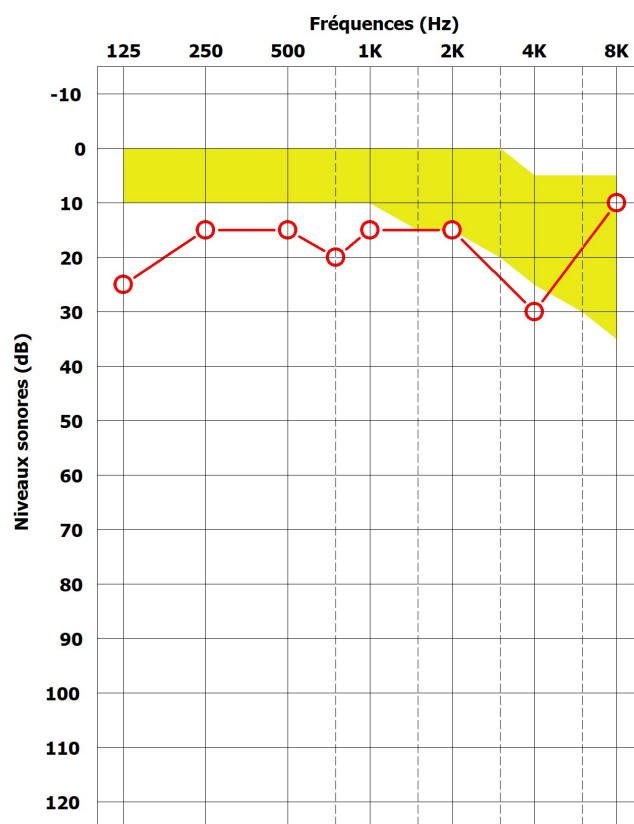

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	30	15	15	20		30		50		20
CA Droit	25	15	15	20	15		15		30		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes