


MEDVIE

Date du test: 11/03/2024 12:21:01

Durée: 1mn 51s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

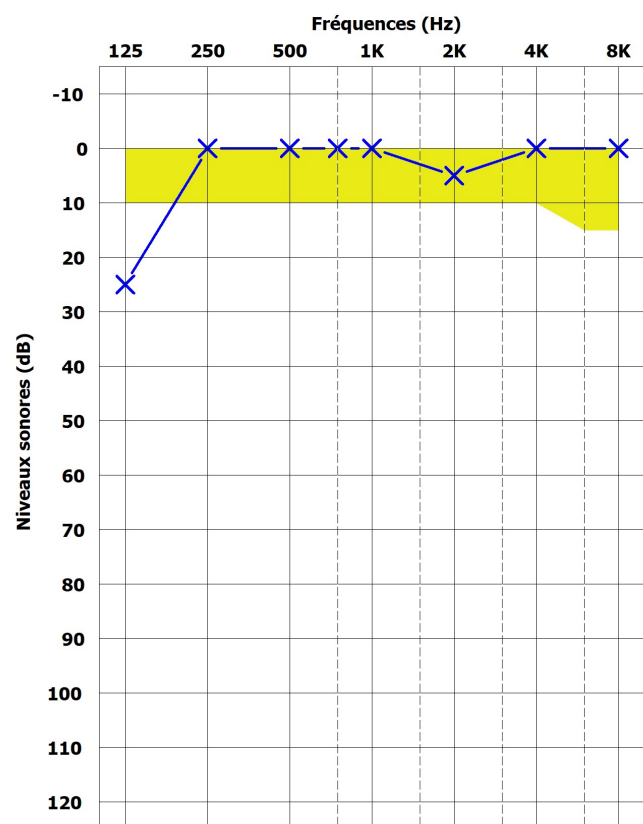

Oreille Gauche

Données Patient	
BAYO SEKOU	
Date de naissance	15/07/1991
Age	32
Société	COVEC
ID	24031112185151948

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

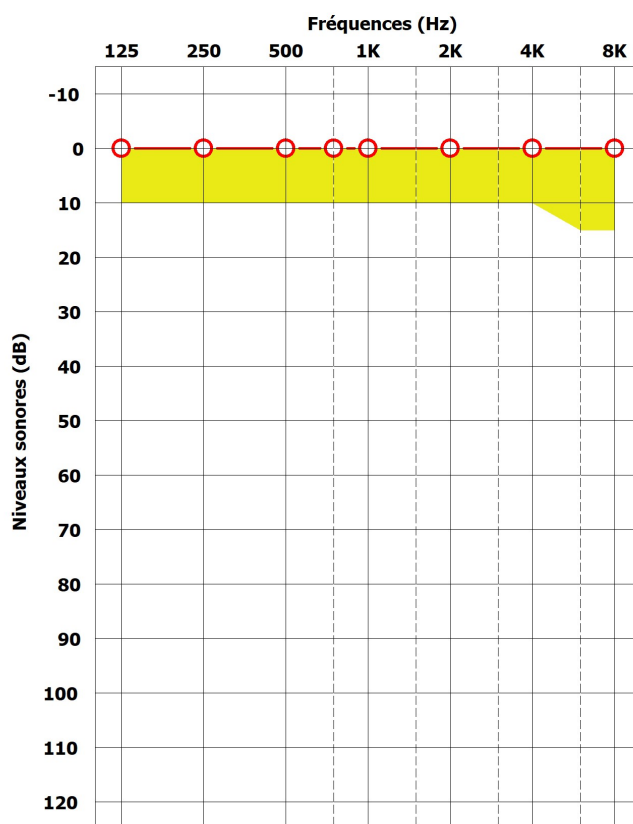

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	0	0	0	0		5		0		0
CA Droit	0	0	0	0	0		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes