

MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 14:37:07

Durée: 6mn 02s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SOUMAORO MOHAMED
Date de naissance	25/11/2000
Age	23
Société	COVEC
ID	24021914351694852

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

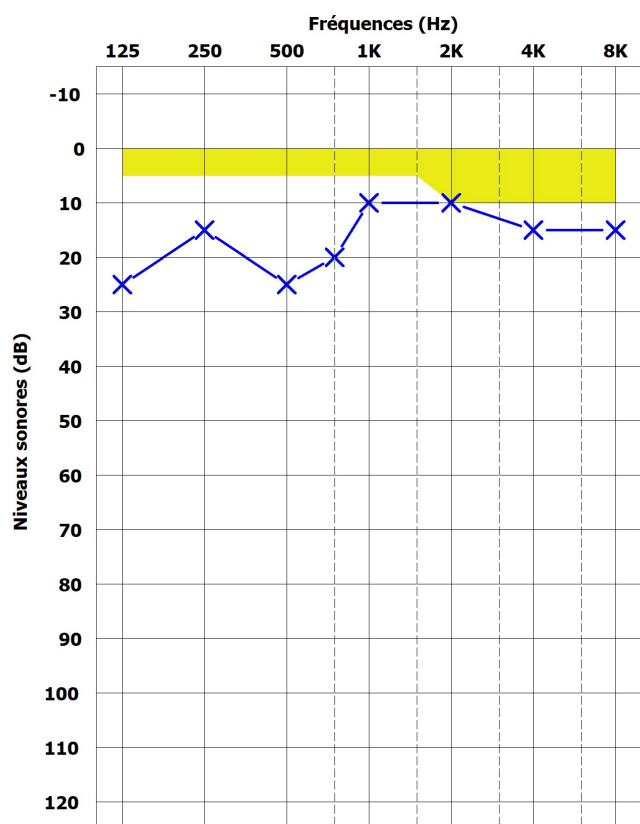

Oreille Gauche

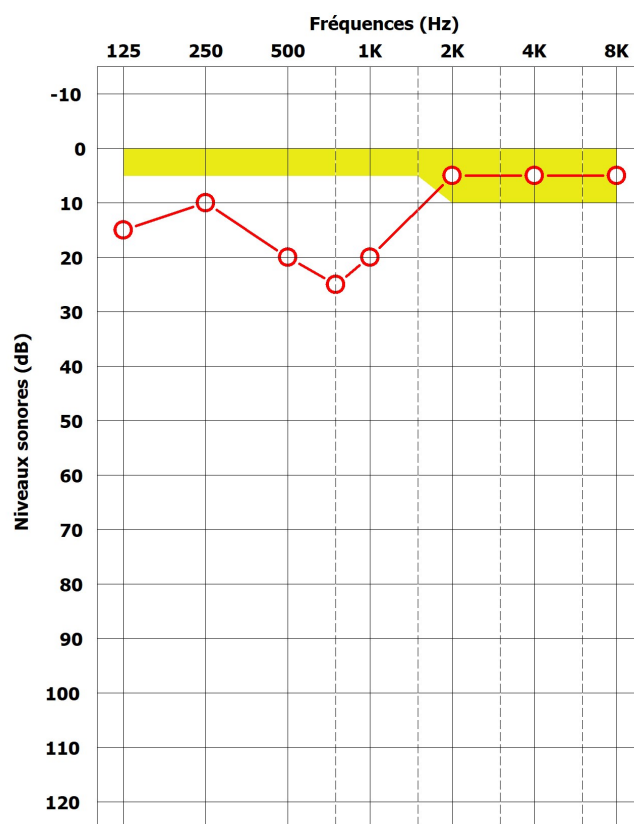

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	25	20	10		10		15		15
CA Droit	15	10	20	25	20		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes