

MEDVIE


Date du test: 23/05/2024 15:03:18

Durée: 5mn 16s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		KOIVOGUI FOROMO
Date de naissance	15/01/1988	
Age	36	
Société	COVEC	
ID	24052315005381962	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

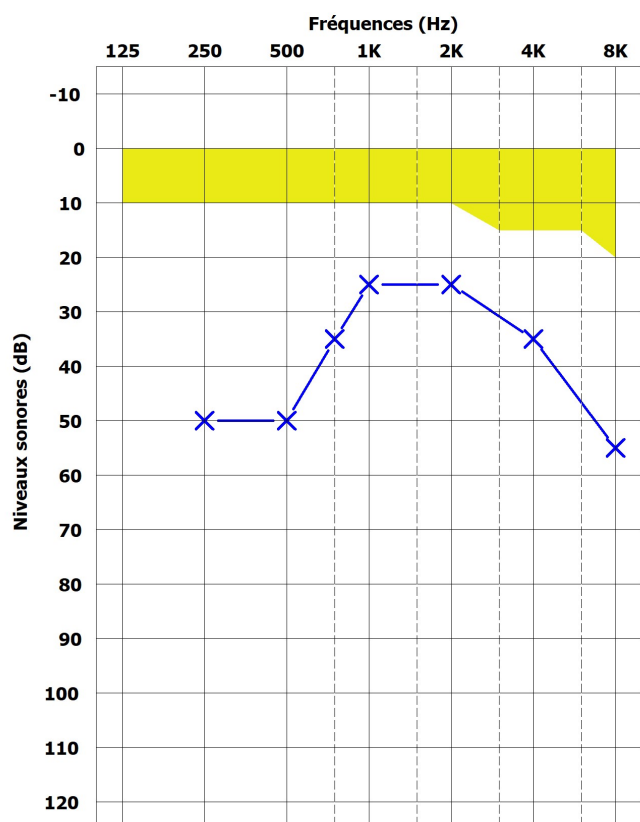

Oreille Gauche

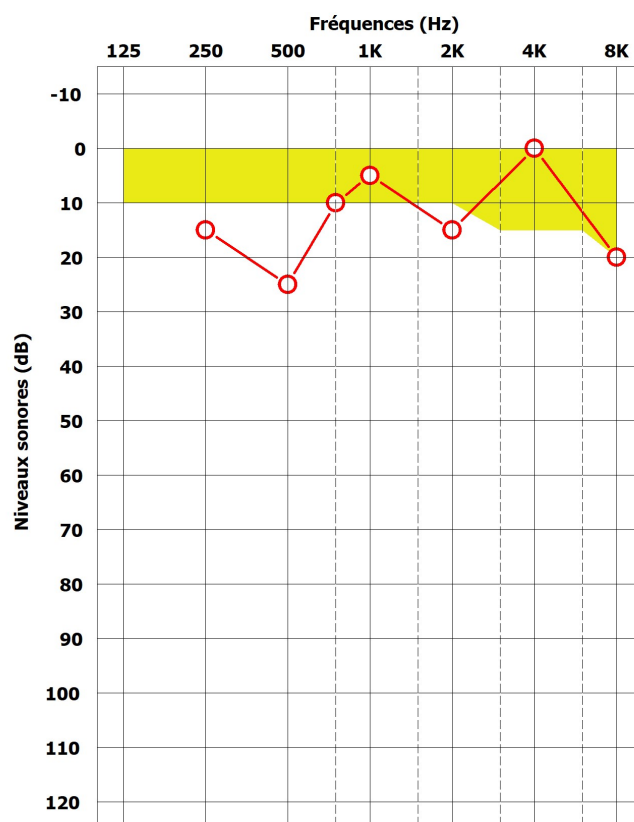

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		50	50	35	25		25		35		55
CA Droit		15	25	10	5		15		0		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	33,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes