

MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 14:28:51

Durée: 5mn 35s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BREHEMOU FASSOU	
Date de naissance	01/01/1988
Age	36
Société	COVEC
ID	24022414263462345

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

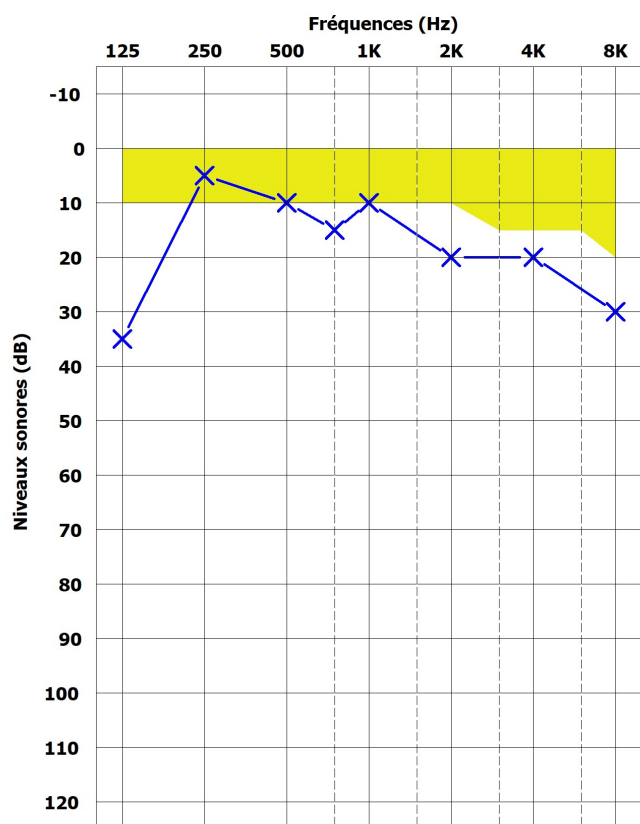

Oreille Gauche

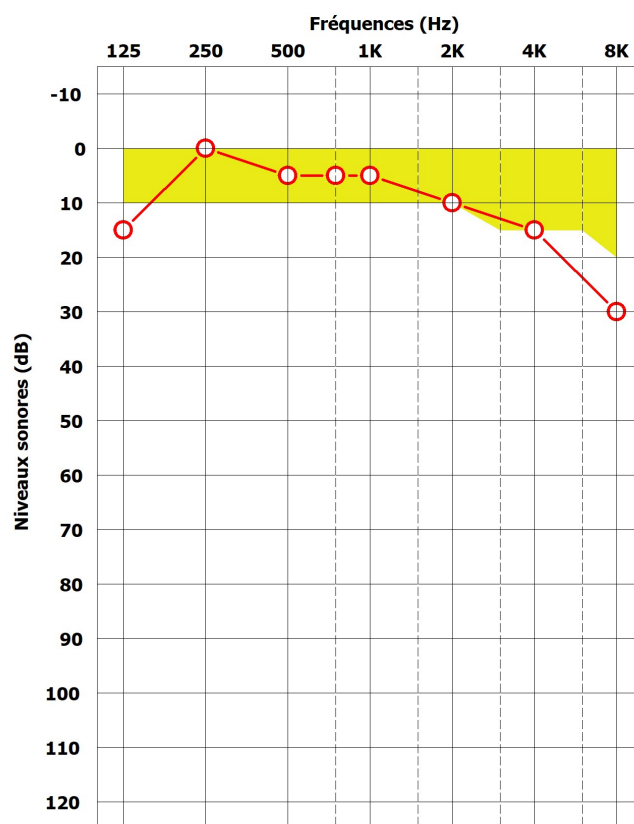

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	5	10	15	10		20		20		30
CA Droit	15	0	5	5	5		10		15		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes