

MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 11:51:46

Durée: 3mn 51s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA LANCINET	
Date de naissance	20/09/1988
Age	35
Société	COVEC
ID	24031111494354894

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

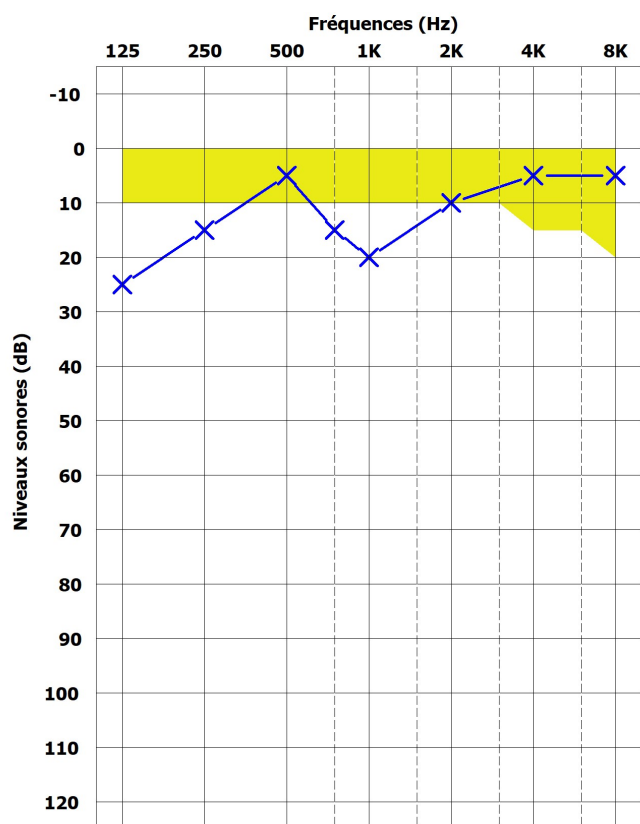

Oreille Gauche

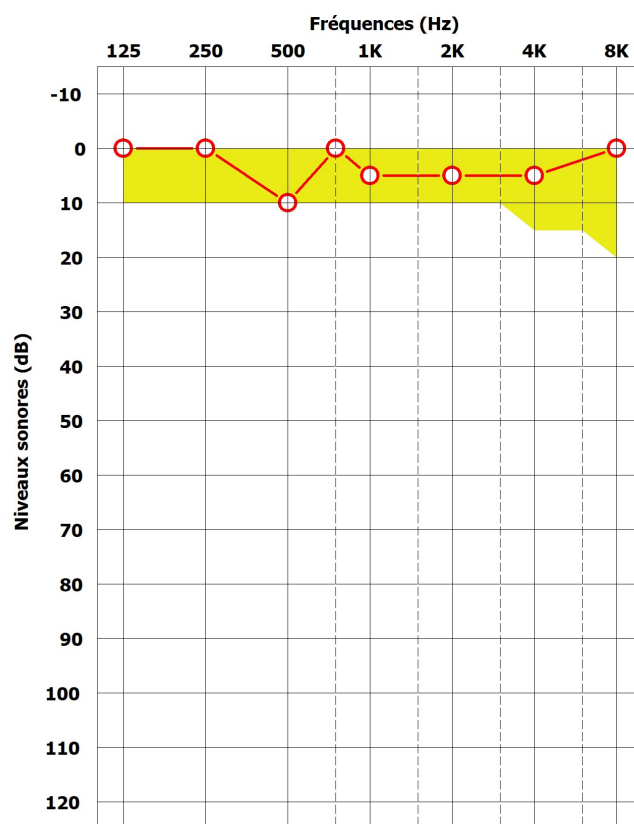

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	5	15	20		10		5		5
CA Droit	0	0	10	0	5		5		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes