

MEDVIE


Date du test: 13/03/2024 09:36:13

Durée: 3mn 59s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAH M'BEMBA	
Date de naissance	10/05/1988
Age	35
Société	COVEC
ID	24031309271439269

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

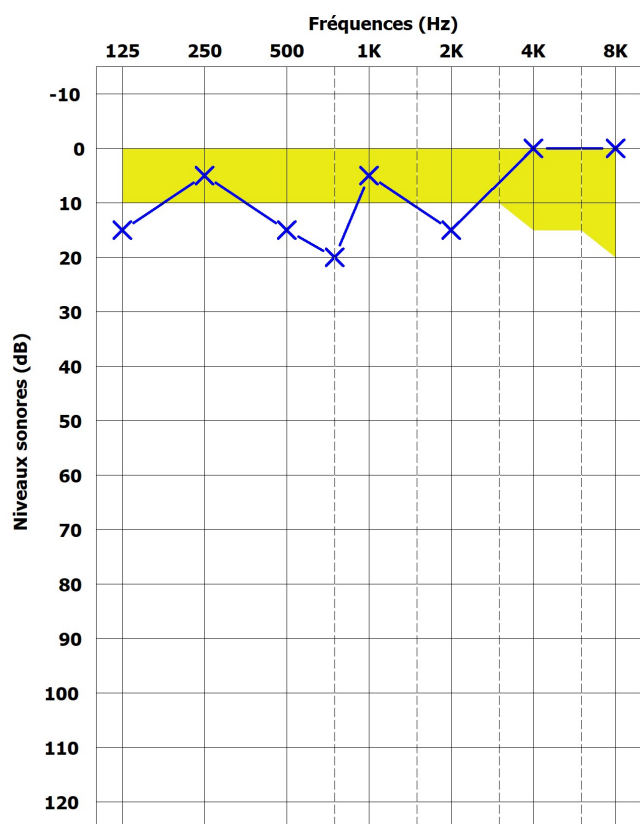

Oreille Gauche

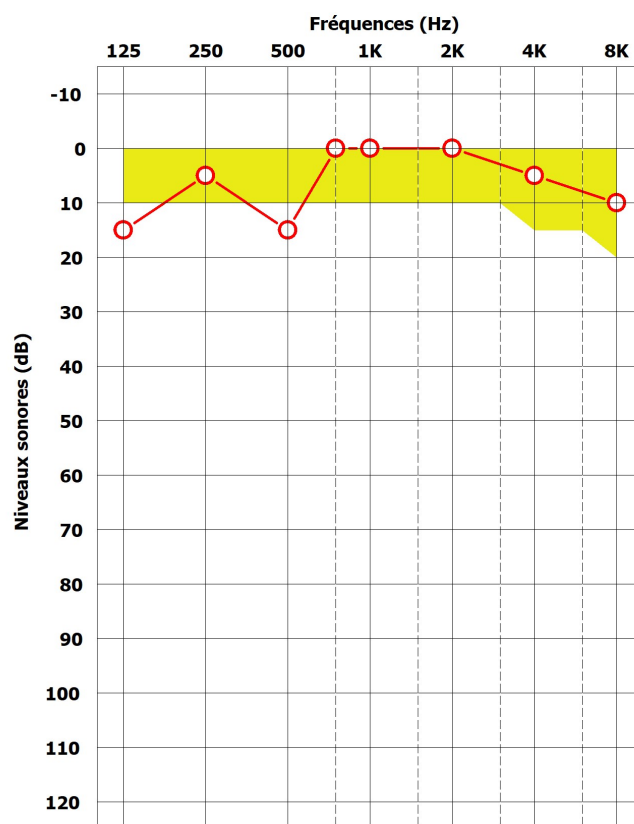

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	5	15	20	5		15		0		0
CA Droit	15	5	15	0	0		0		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes