

MEDVIE


Date du test: 22/02/2024 08:47:25

Durée: 7mn 12s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA SEKOU
Date de naissance	01/01/2002	
Age	22	
Société	COVEC	
ID	24022208445897072	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

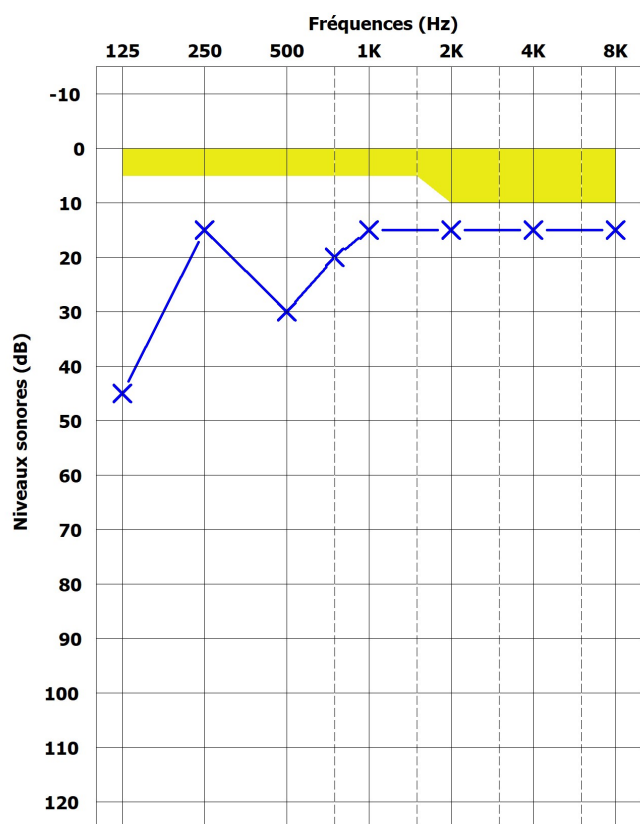

Oreille Gauche

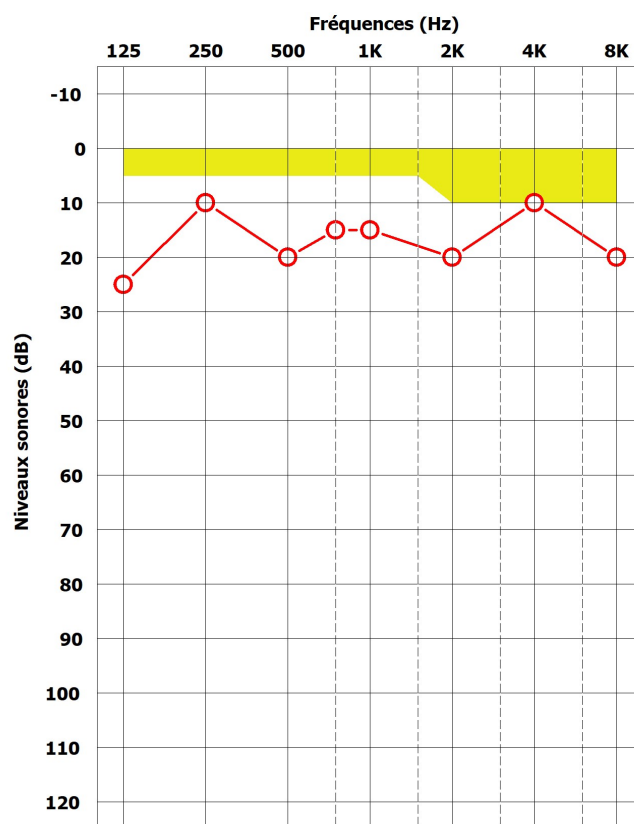

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	15	30	20	15		15		15		15
CA Droit	25	10	20	15	15		20		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes