


MEDVIE


Date du test: 21/08/2024 14:43:35
Durée: 3mn 41s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BALDE MAMADOU SANDI ISSY
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	COVEC
ID	24082114393421029

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

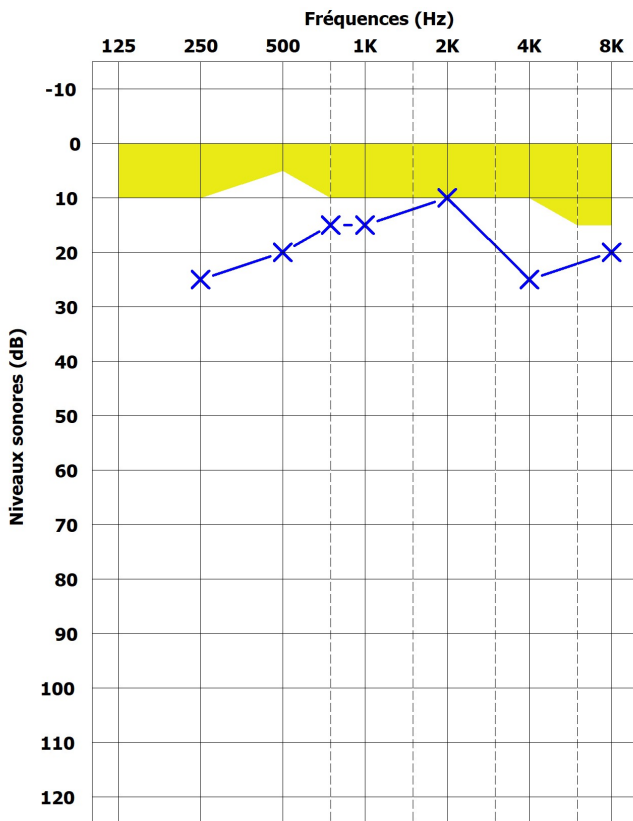

Oreille Gauche

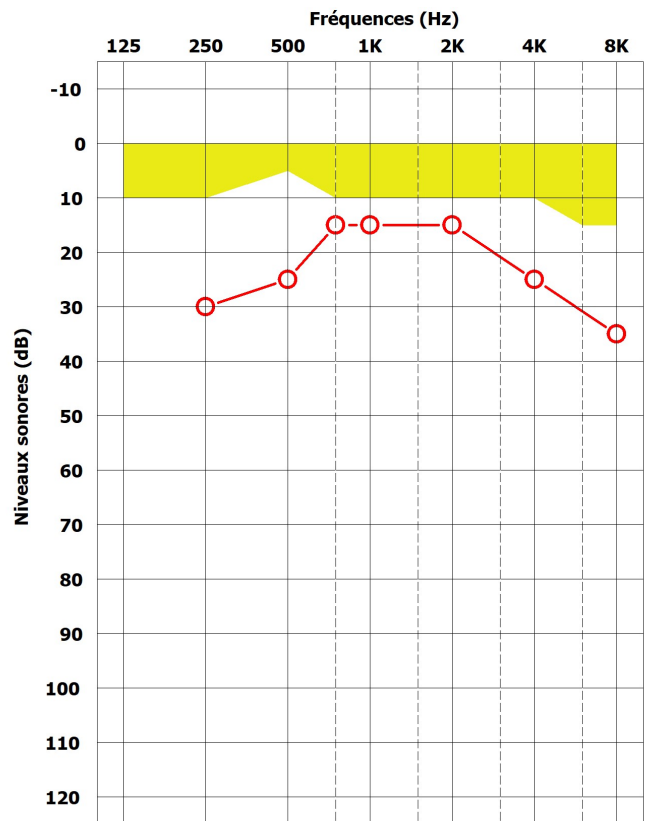

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	15	15		10		25		20
CA Droit		30	25	15	15		15		25		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes