

MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 17:22:58

Durée: 5mn 04s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SQUARE KARAMO
Date de naissance	01/01/1990	
Age	34	
Société	COVEC	
ID	24022417202220085	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

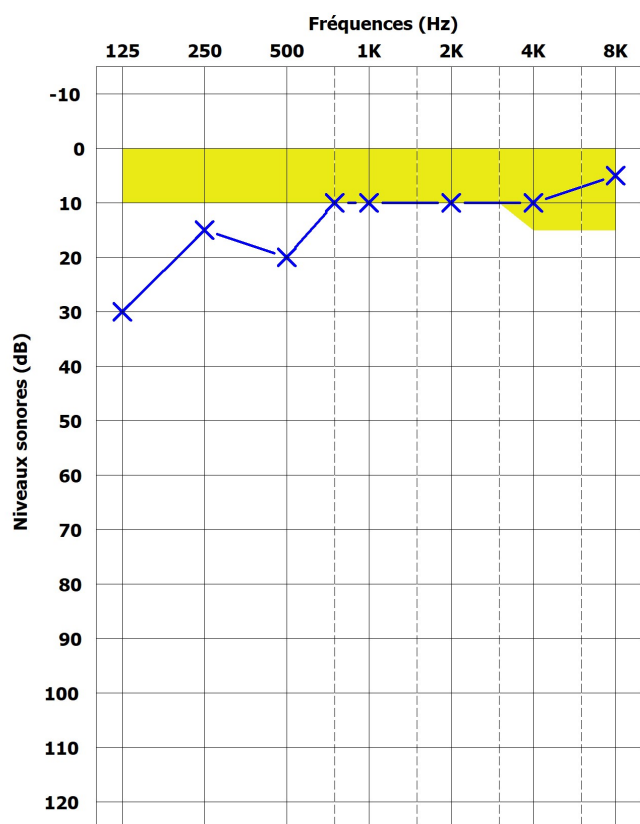

Oreille Gauche

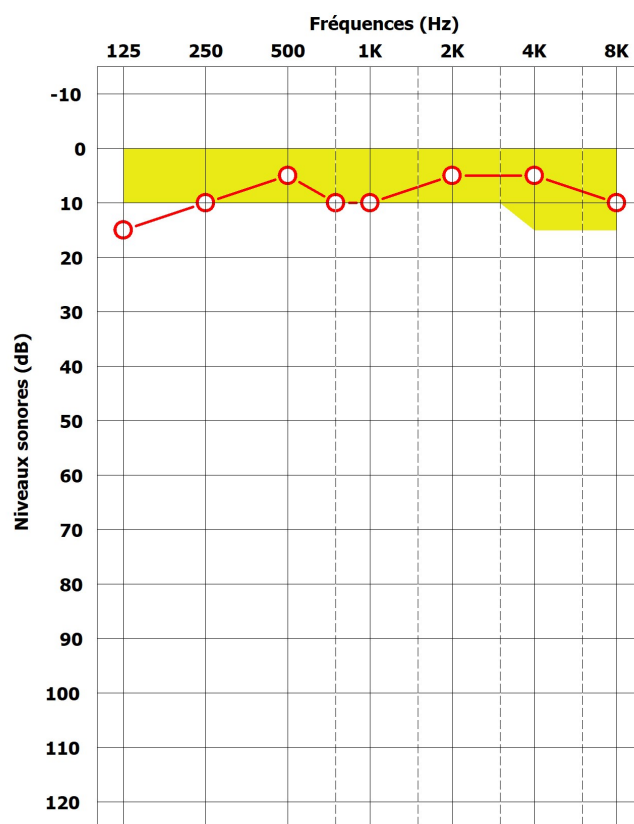

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	15	20	10	10		10		10		5
CA Droit	15	10	5	10	10		5		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes