


MEDVIE

Date du test: 20/02/2024 11:39:32
Durée: 12mn 25s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SANGARE KALILOU
Date de naissance	11/01/1980
Age	44
Société	COVEC
ID	24022011372572295

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

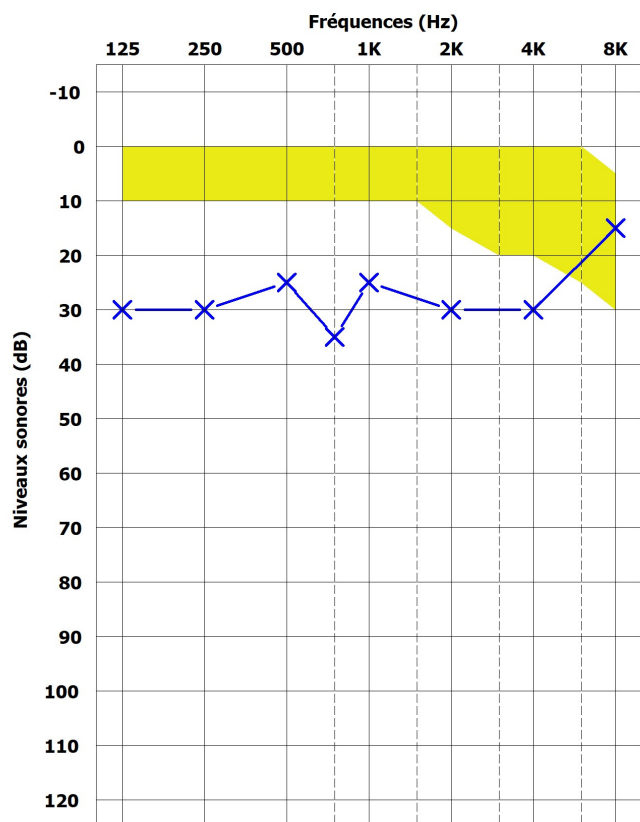

Oreille Gauche



Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	30	25	35	25		30		30		15
CA Droit	25	40	45	45	45		55		50		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	48,8 dB	---

Notes