

MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 16:37:51

Durée: 7mn 08s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		THEORO ALAIN
Date de naissance	01/01/1990	
Age	34	
Société	COVEC	
ID	24022416341977709	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

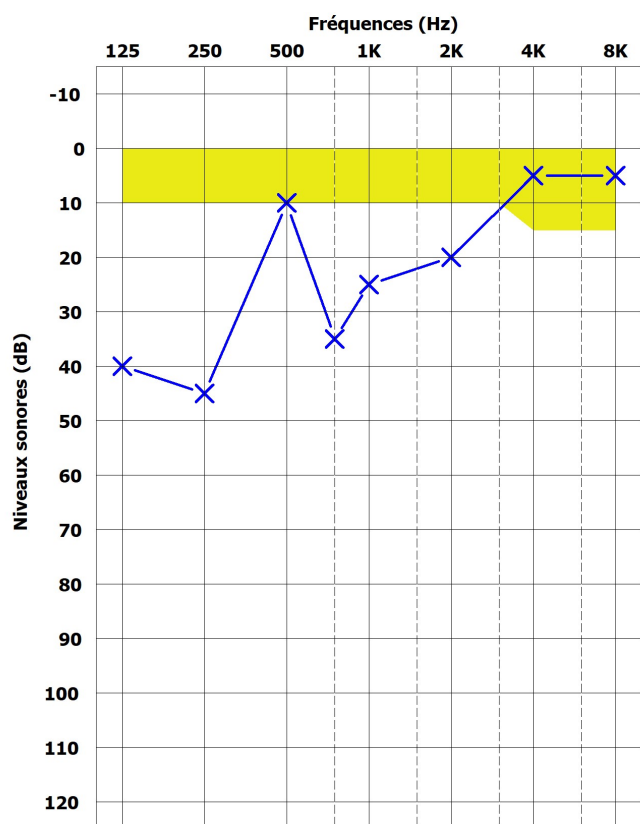

Oreille Gauche

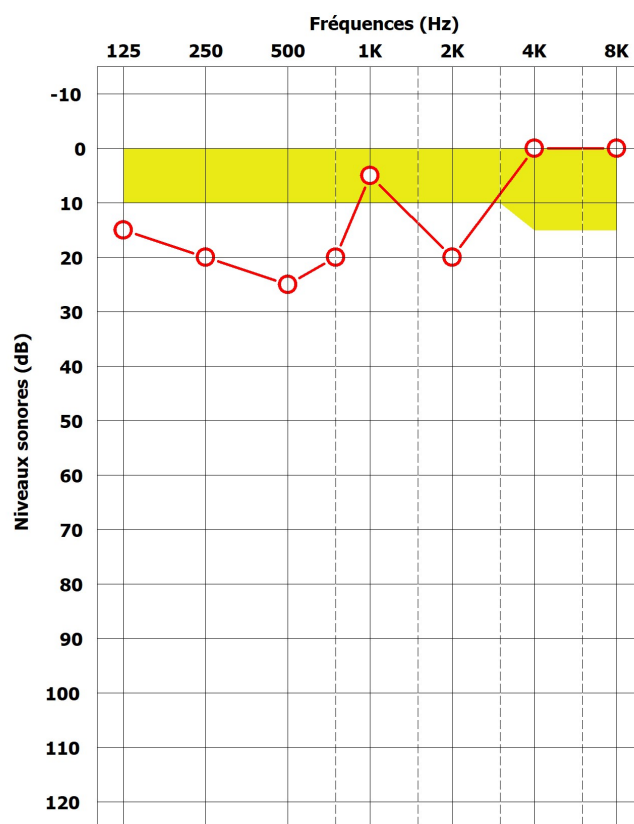

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	45	10	35	25		20		5		5
CA Droit	15	20	25	20	5		20		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes