


MEDVIE


Date du test: 11/03/2024 13:03:40
Durée: 3mn 00s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SAGARE MAMADY
Date de naissance	05/07/1994
Age	29
Société	COVEC
ID	24031113000289120

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

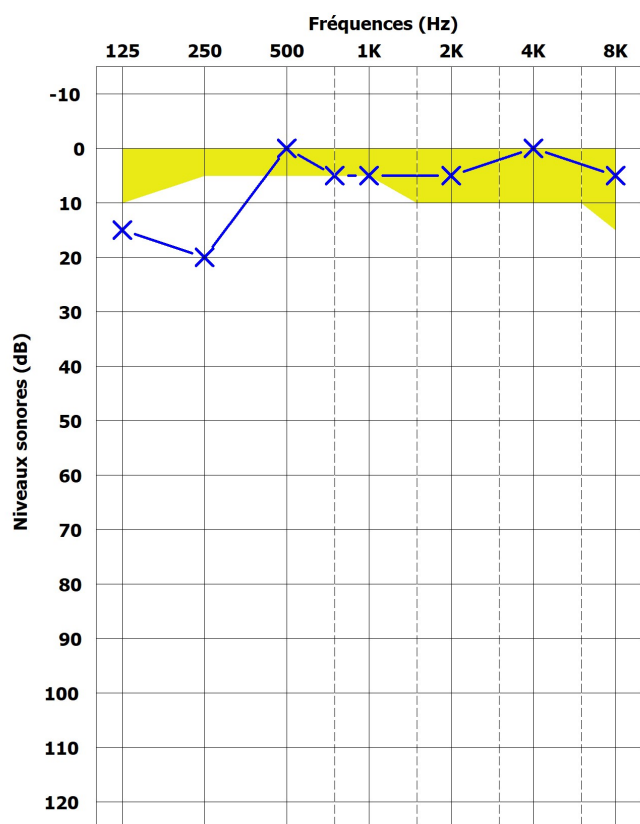

Oreille Gauche

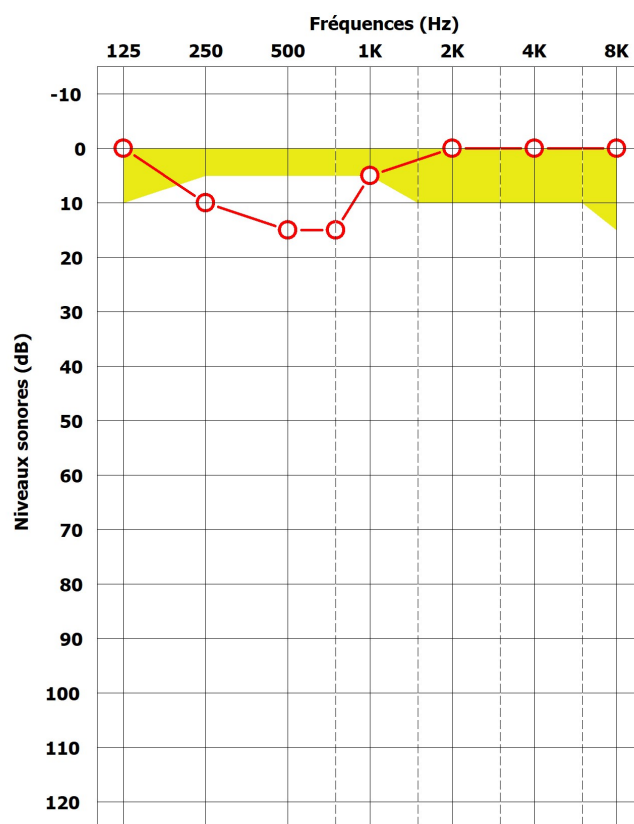

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	0	5	5		5		0		5
CA Droit	0	10	15	15	5		0		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes