

MEDVIE

Date du test: 22/02/2024 10:21:27

Durée: 5mn 11s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

TOUARO SIBA

Date de naissance 05/10/1979

Age 44

Société COVEC


ID 24022210184975710

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

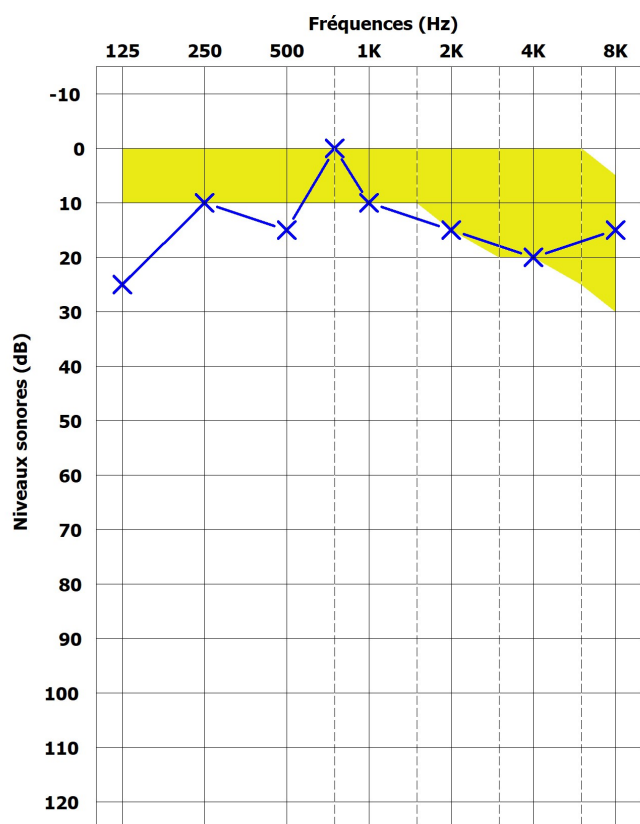

Oreille Gauche

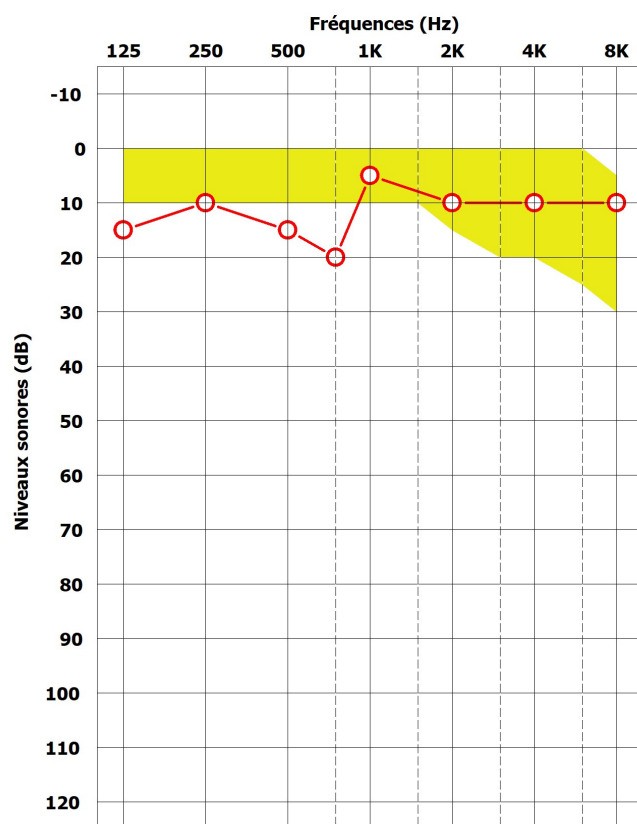

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	10	15	0	10		15		20		15
CA Droit	15	10	15	20	5		10		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes