


MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 13:42:19
Durée: 5mn 49s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SIDIBE MOUSSA	
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	COVEC
ID	24021913403441141

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

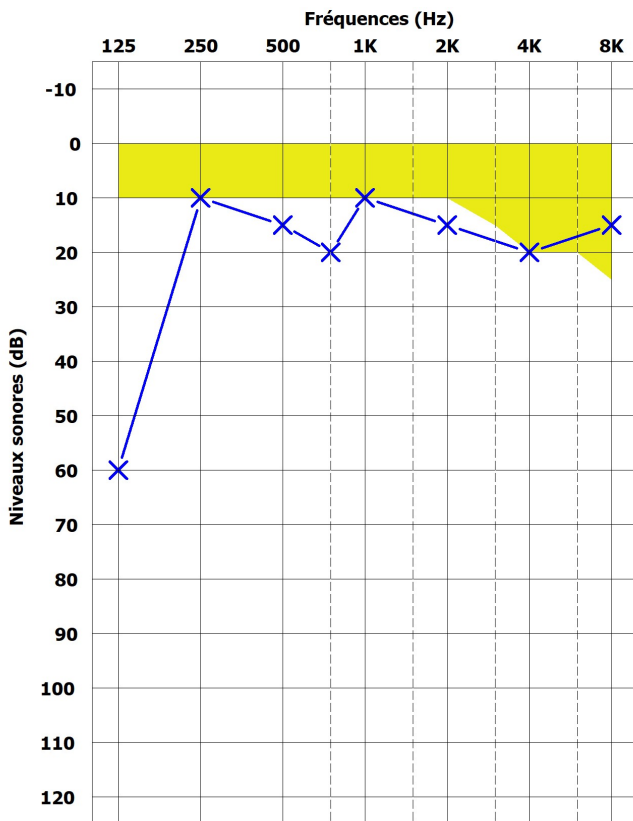

Oreille Gauche

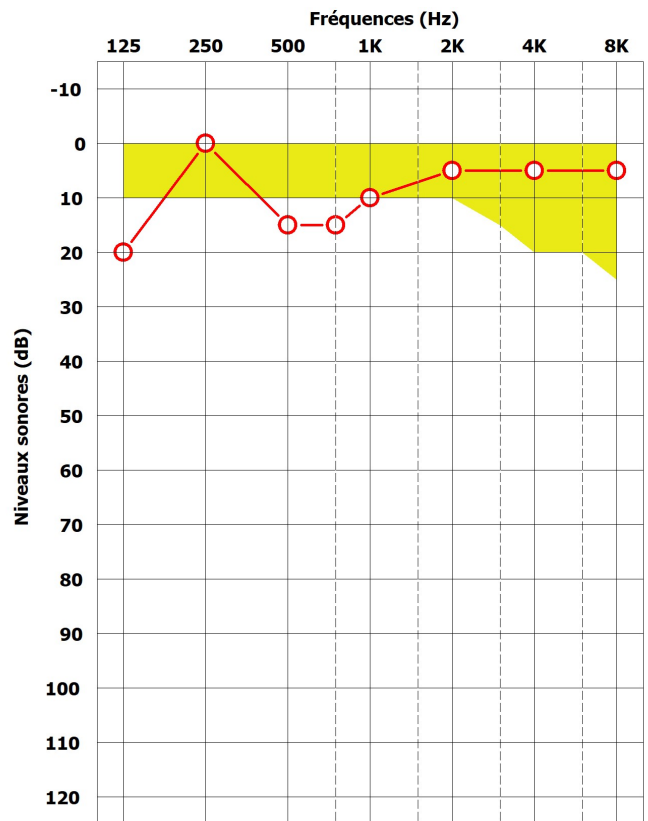

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	60	10	15	20	10		15		20		15
CA Droit	20	0	15	15	10		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes