

MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 12:00:16

Durée: 7mn 52s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KONE AYOUBA
Date de naissance	01/01/1980
Age	44
Société	COVEC
ID	24021911574032962

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

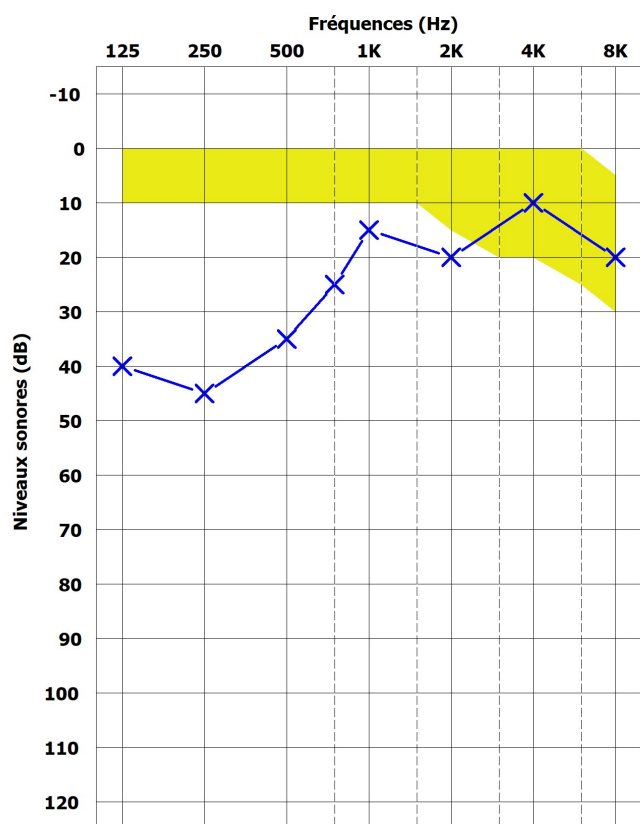

Oreille Gauche

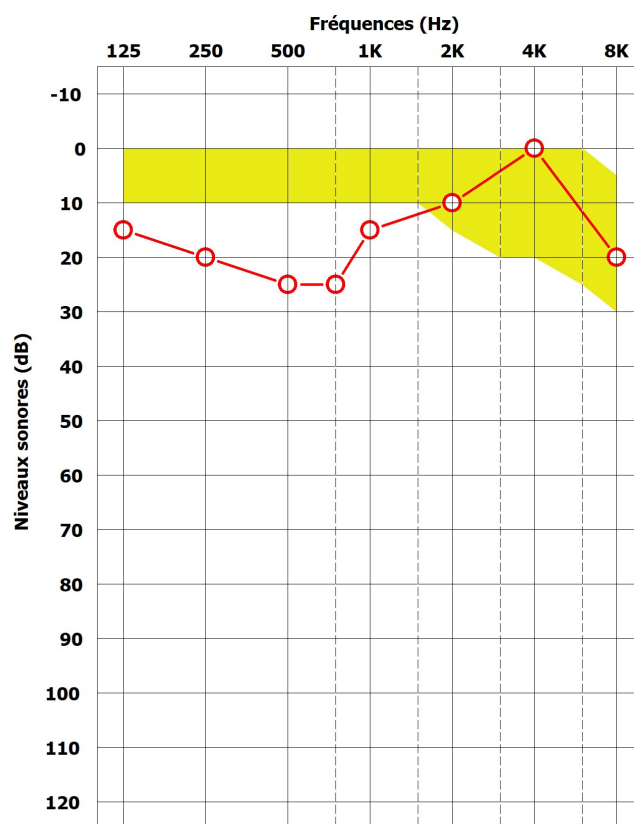

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	45	35	25	15		20		10		20
CA Droit	15	20	25	25	15		10		0		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes