


MEDVIE

Date du test: 05/10/2024 10:51:00

Durée: 2mn 27s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

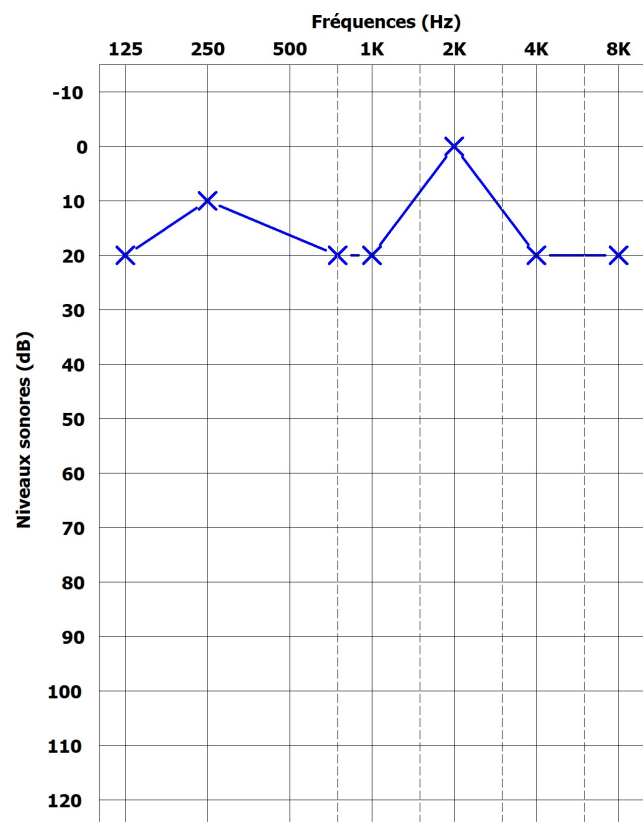

Oreille Gauche

Données Patient		SIDIBE NOUHAN
Date de naissance	01/01/2004	
Age	20	
Société	COVEC	
ID	24100510485135176	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

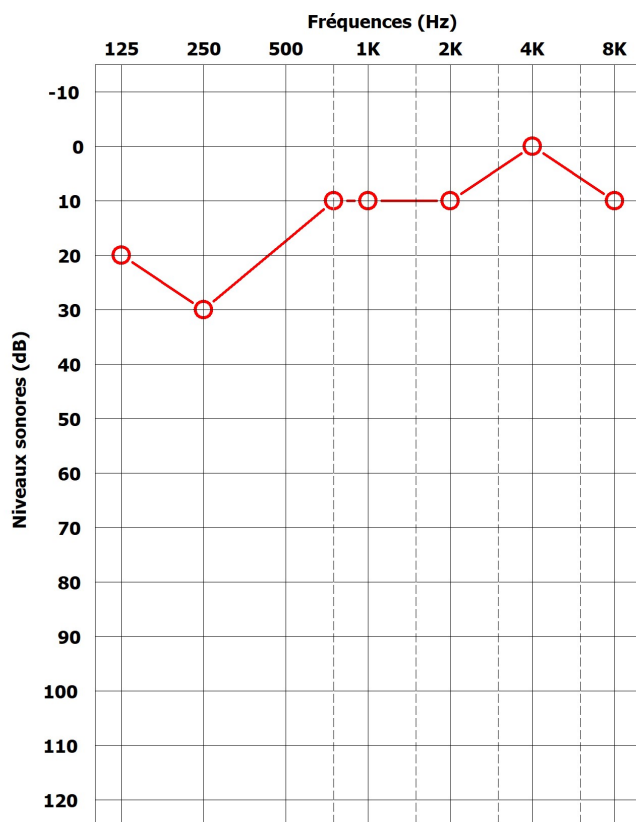

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10		20	20		0		20		20
CA Droit	20	30		10	10		10		0		10

Calcul de perte	PAM
CA Gauche	---
CA Droit	---

Notes