

MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 17:43:59

Durée: 5mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		BEAVOGUI AKOÏ
Date de naissance		27/09/1988
Age		35
Société		COVEC
ID		24022417413648080

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

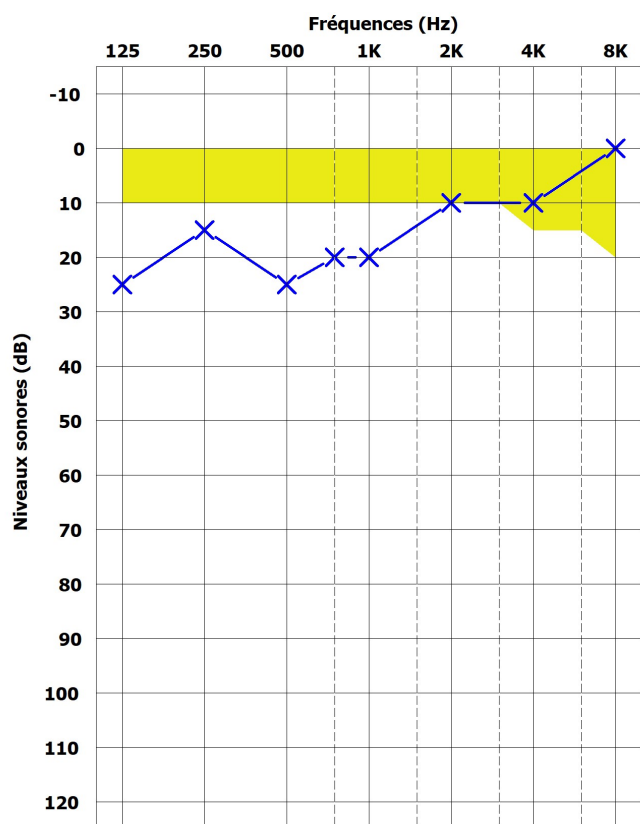

Oreille Gauche

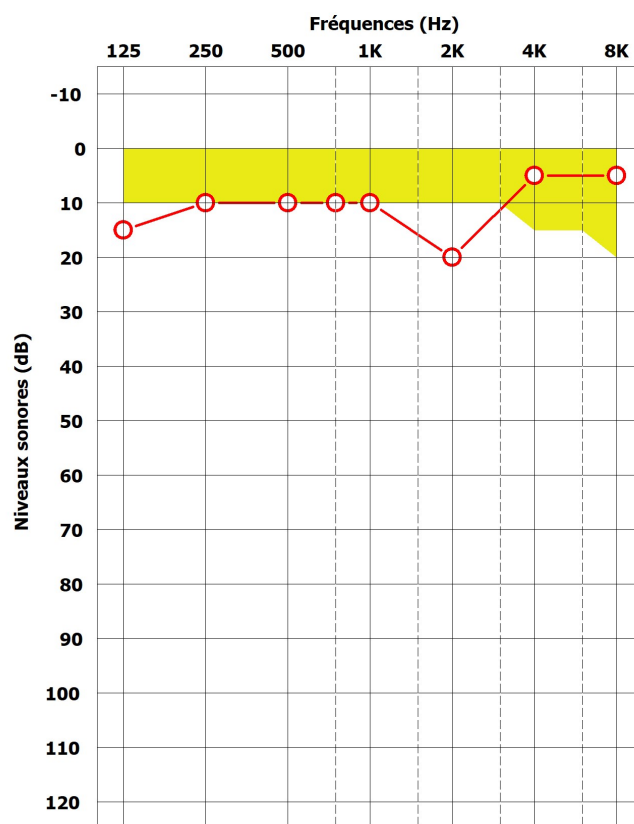

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	25	20	20		10		10		0
CA Droit	15	10	10	10	10		20		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes