

MEDVIE


Date du test: 24/02/2024 12:52:11

Durée: 5mn 41s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIABATE ISMAEL
Date de naissance	01/01/1985	
Age	39	
Société	COVEC	
ID	24022412491985274	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

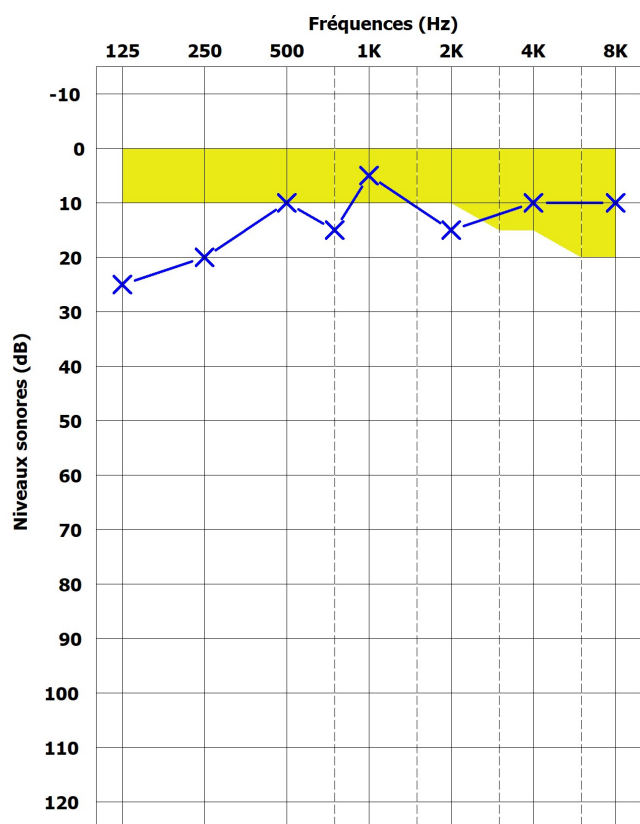

Oreille Gauche

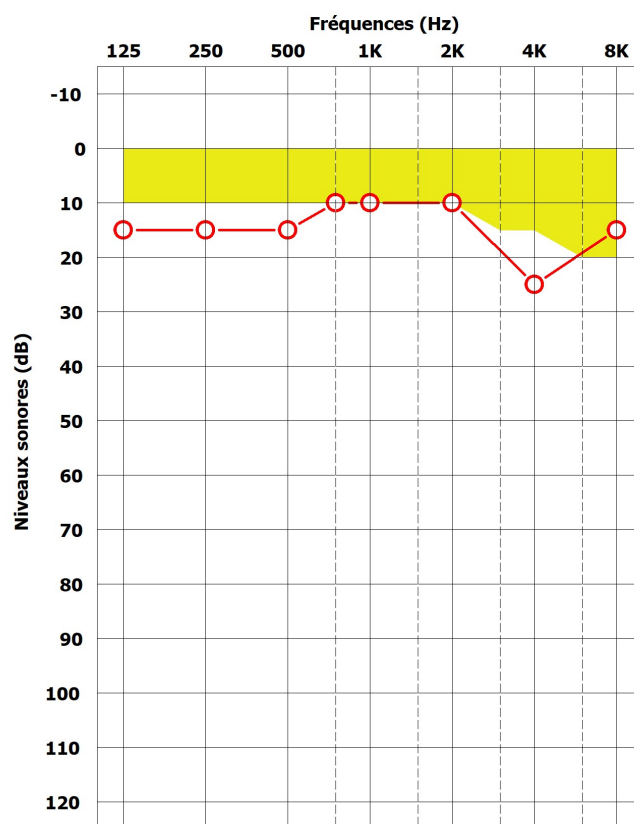

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	10	15	5		15		10		10
CA Droit	15	15	15	10	10		10		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes