


MEDVIE


Date du test: 19/02/2024 13:15:00
Durée: 7mn 43s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIAKITE VACE
Date de naissance	01/01/1984	
Age	40	
Société	COVEC	
ID	24021913120202887	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

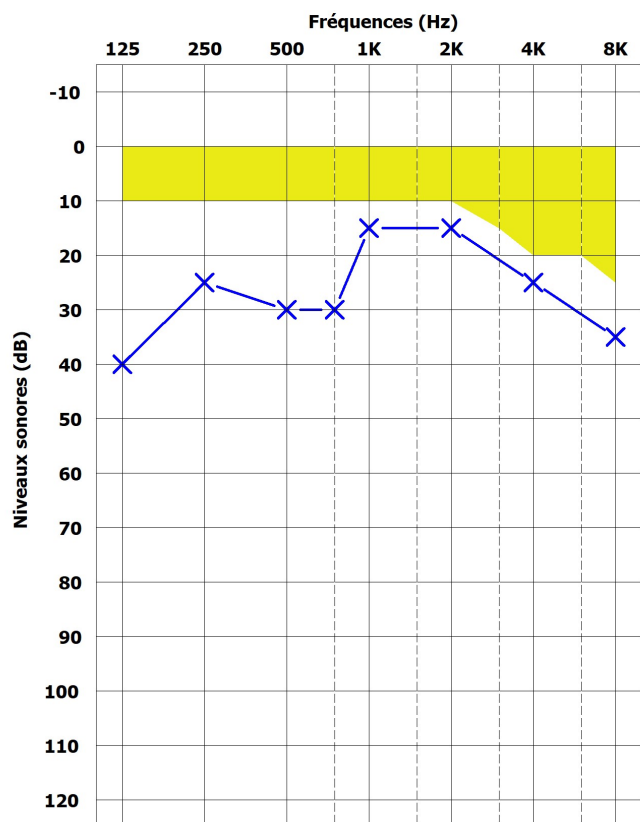

Oreille Gauche

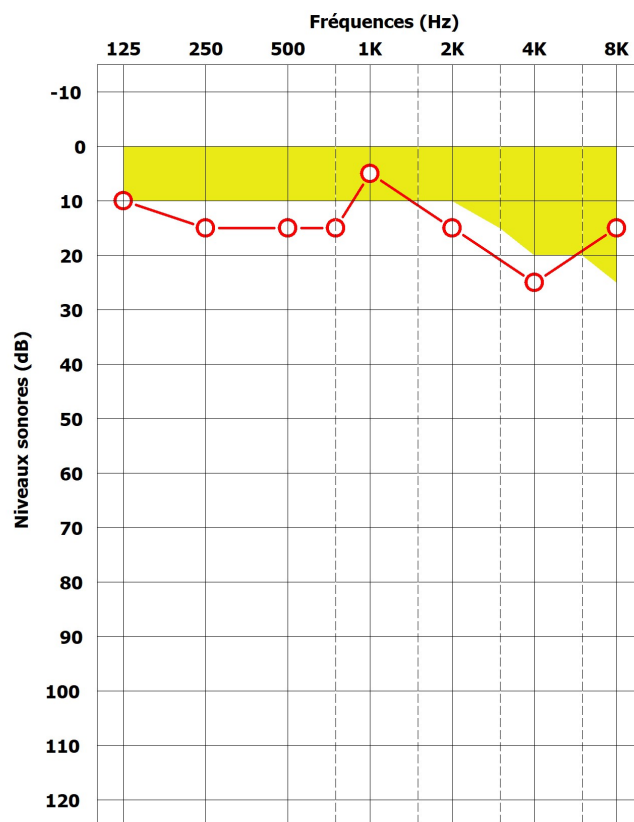

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	25	30	30	15		15		25		35
CA Droit	10	15	15	15	5		15		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes